

MEDVIE BEYLA


Date du test: 18/12/2024 11:58:44

Durée: 7mn 46s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SACKO SAIDOU V
Date de naissance	02/10/1999
Age	25
Société	CR18
ID	24121811572016241

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

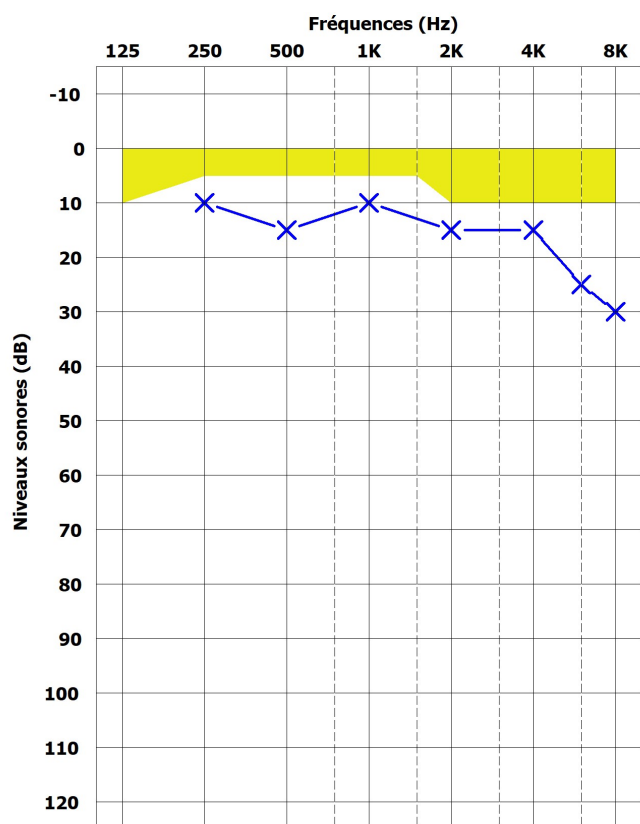

Oreille Gauche

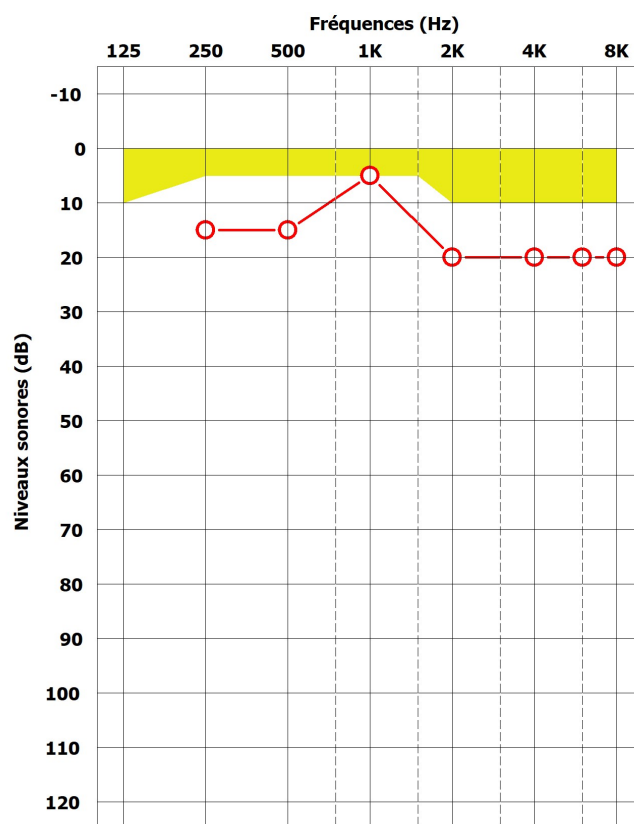

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15		10		15		15	25	30
CA Droit		15	15		5		20		20	20	20

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	10,0 dB
CA Droit	---	5,0 dB

Notes