

MEDVIE

Date du test: 16/05/2024 10:09:32


Durée: -- mn -- s

Type test Manuel


Continu

Données Patient	
KOUKOUMA FATOUMA MAMADY	
Date de naissance	01/01/2001
Age	23
Société	CR18
ID	24051610044856182

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

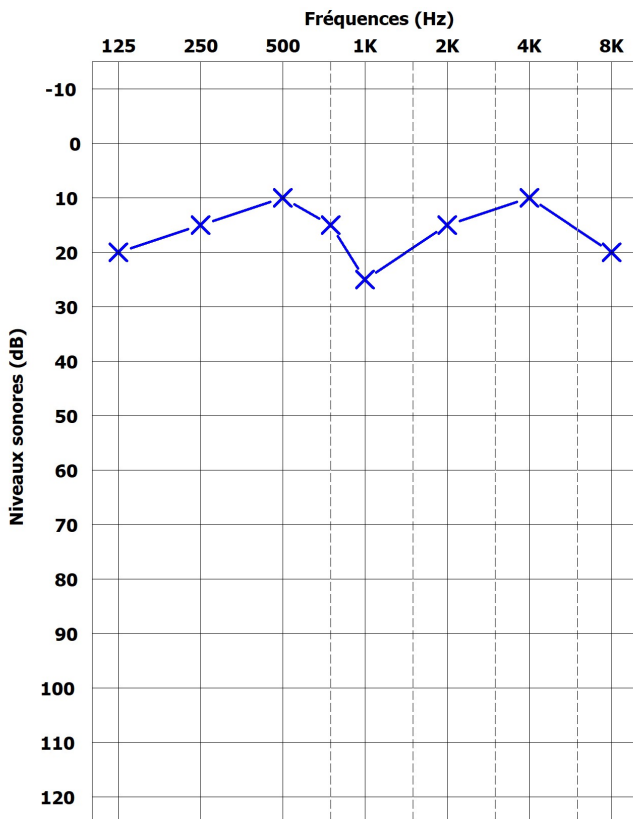

Oreille Gauche

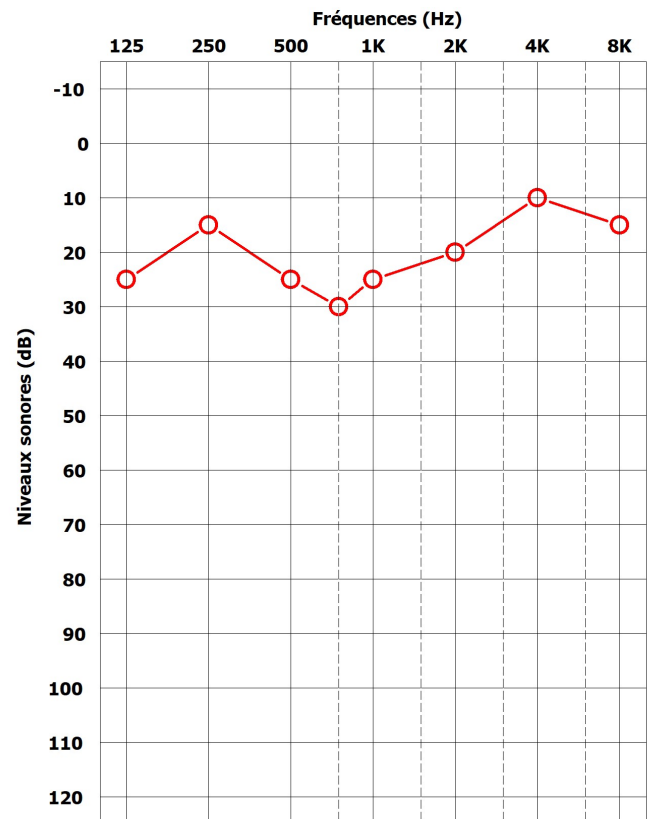

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	10	15	25		15		10		20
CA Droit	25	15	25	30	25		20		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes