

MEDVIE BEYLA


Date du test: 18/12/2024 14:10:08

Durée: 4mn 30s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   |                   |
|-------------------|-------------------|
| CAMARA MOHAMED    |                   |
| Date de naissance | 15/09/2000        |
| Age               | 24                |
| Société           | CR18              |
| ID                | 24121814072228933 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

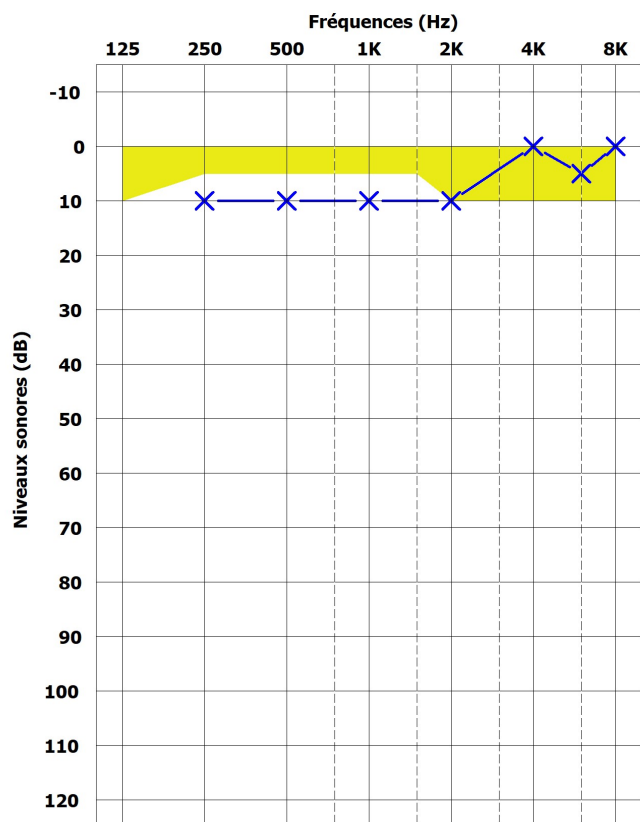

Oreille Gauche

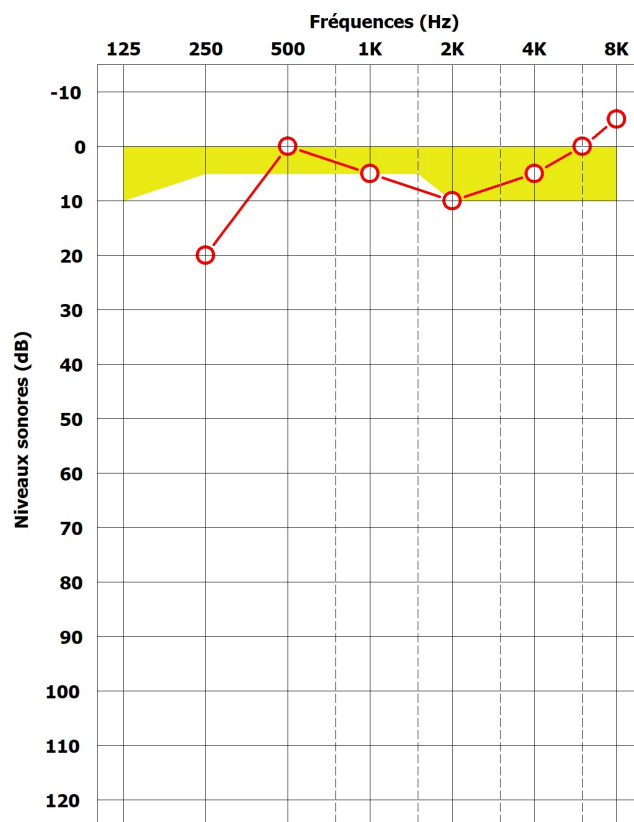

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 10  | 10  |     | 10 |     | 10 |    | 0  | 5  | 0  |
| CA Droit  |     | 20  | 0   |     | 5  |     | 10 |    | 5  | 0  | -5 |

| Calcul de perte | PAM |         |
|-----------------|-----|---------|
| CA Gauche       | --- | 10,0 dB |
| CA Droit        | --- | 5,0 dB  |

Notes