

MEDVIE


Date du test: 12/03/2025 10:56:06

Durée: 5mn 41s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	BERETE OUMAR
Date de naissance	17/06/1996
Age	28
Société	CR18
ID	25031210503693932

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

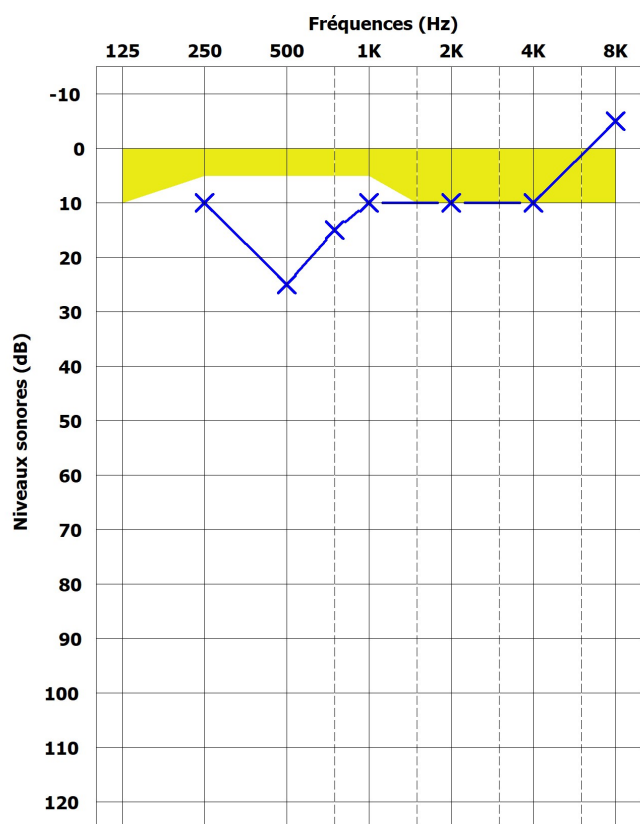

Oreille Gauche

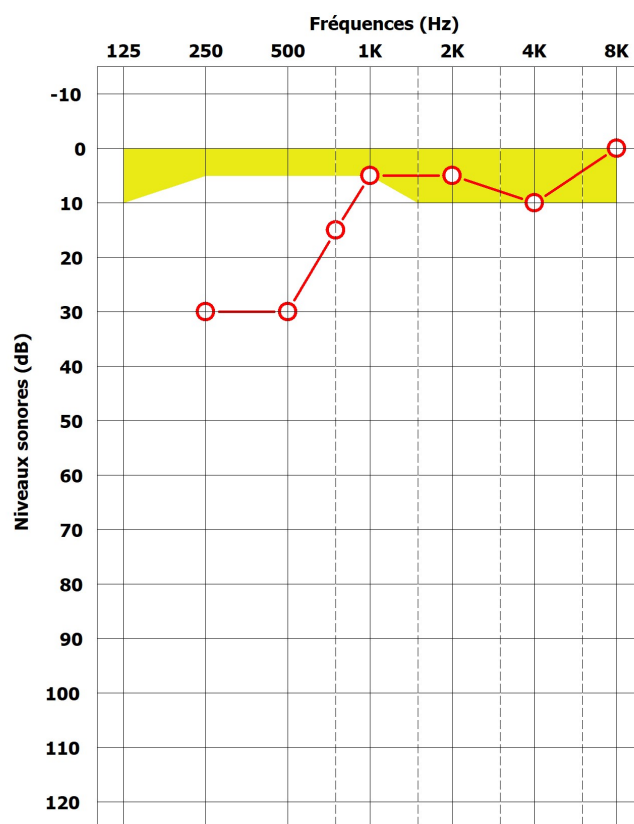

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	15	10		10		10		-5
CA Droit		30	30	15	5		5		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes