



Données Patient		FOFANA SIDIKI
Date de naissance	10/01/1996	
Age	28	
Société	CR18	
ID	24050813161539538	

Date du test: 08/05/2024 13:21:53
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

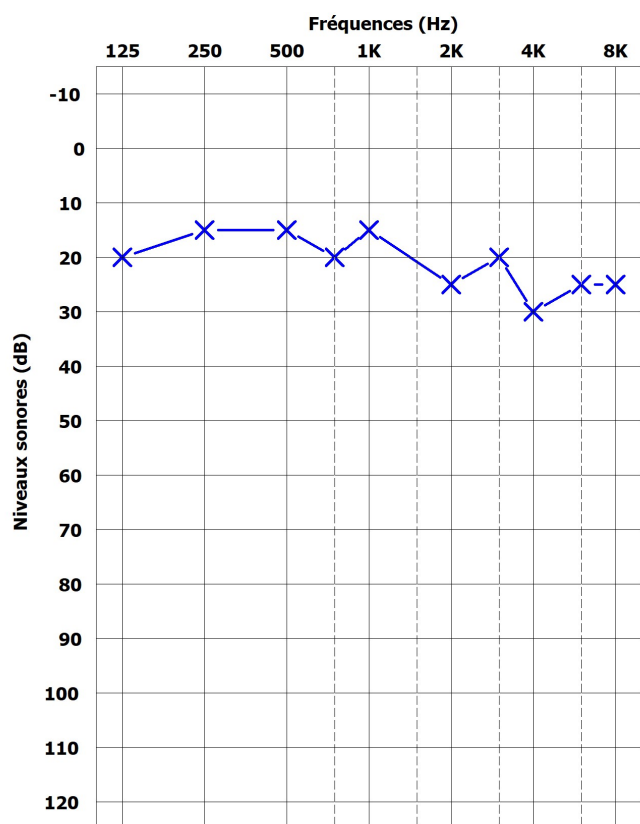

Oreille Gauche

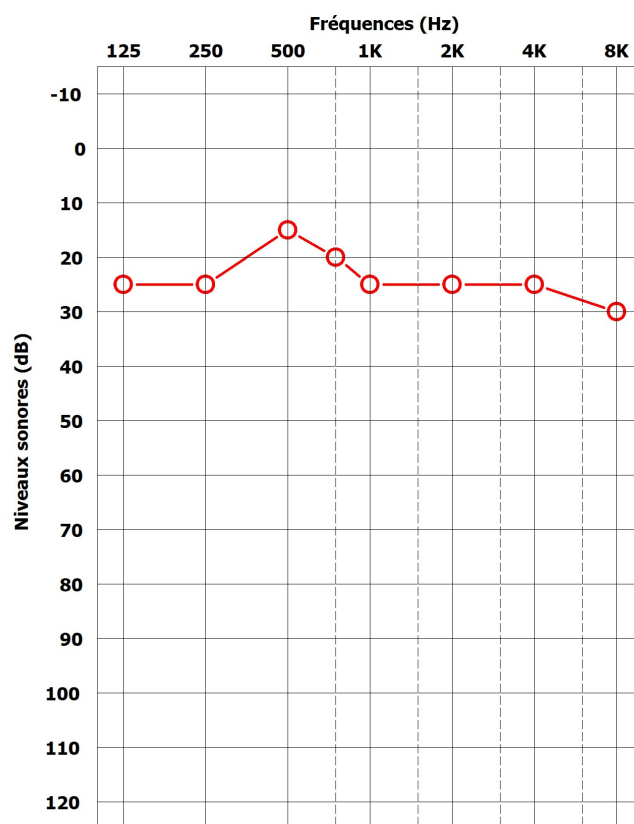

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	15	20	15		25	20	30	25	25
CA Droit	25	25	15	20	25		25		25		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	25,0 dB
CA Droit	22,5 dB	---

Notes