

MEDVIE


Date du test: 12/03/2025 12:02:38

Durée: 3mn 52s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
ZHANG WEITAO	
Date de naissance	08/02/1987
Age	38
Société	CR18
ID	25031212005489318

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

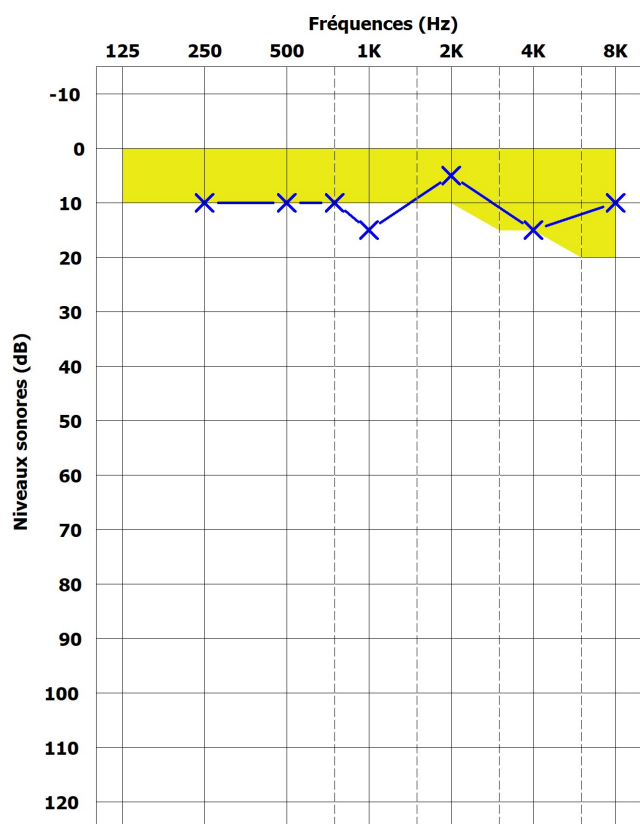

Oreille Gauche

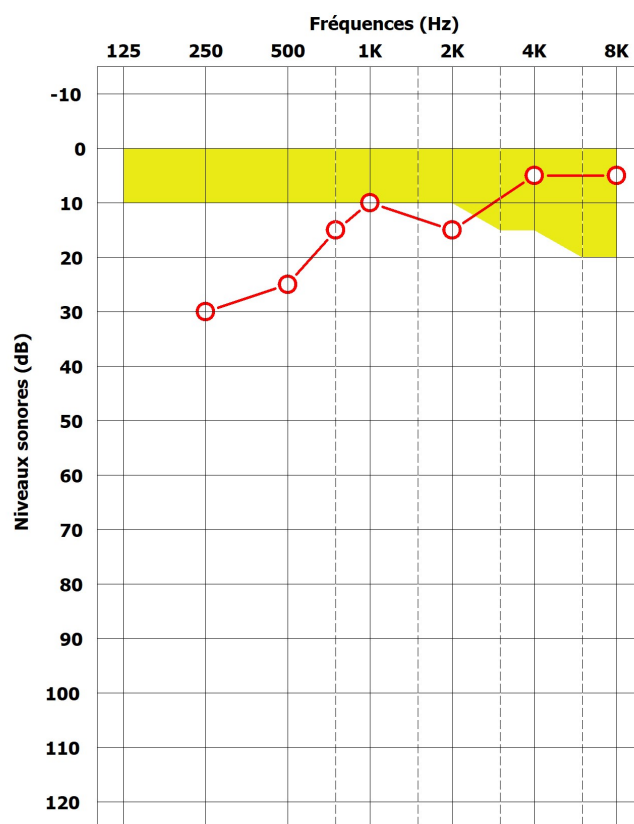

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	10	15		5		15		10
CA Droit		30	25	15	10		15		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes