


MEDVIE


Date du test: 17/05/2024 14:48:39
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
TRAORE MAMADOU	
Date de naissance	01/01/2004
Age	20
Société	CR18
ID	24051714445123877

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

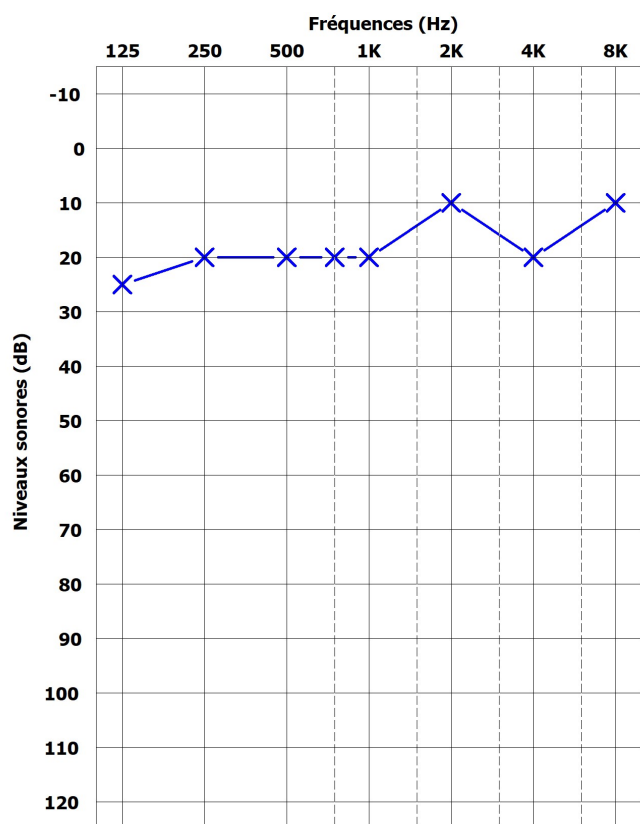

Oreille Gauche

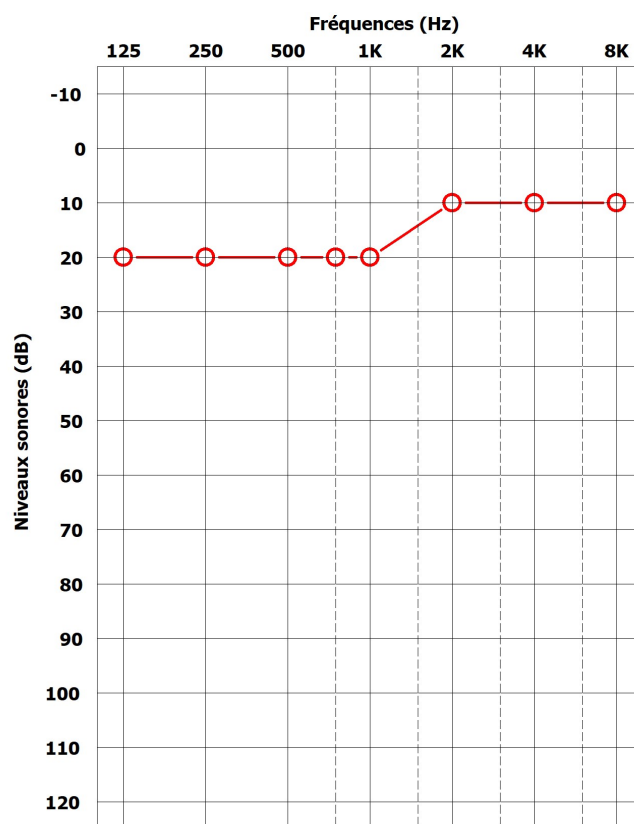

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	20	20	20	20		10		20		10
CA Droit	20	20	20	20	20		10		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes