


MEDVIE


Date du test: 15/05/2024 08:47:24
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient		DIALLO FODE
Date de naissance	01/01/1979	
Age	45	
Société	CR18	
ID	24050217420796027	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

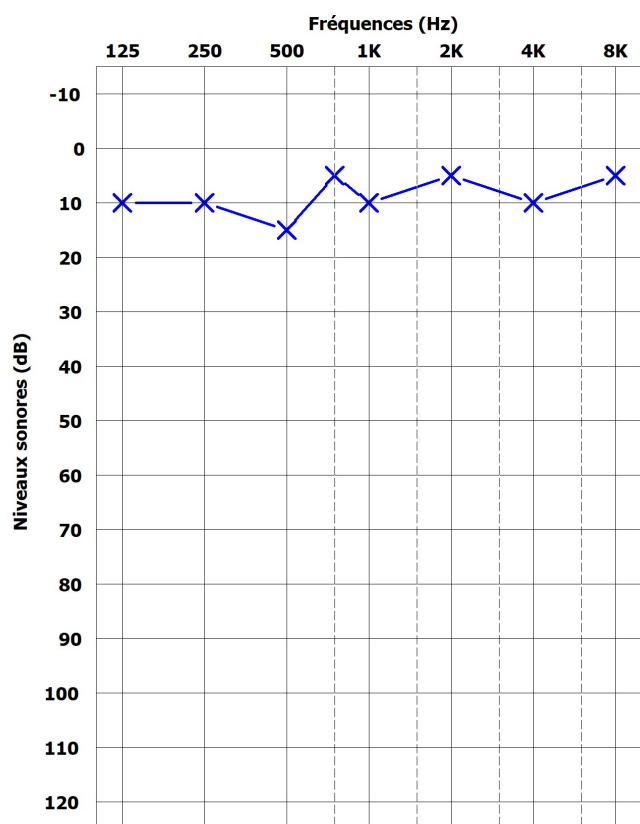

Oreille Gauche

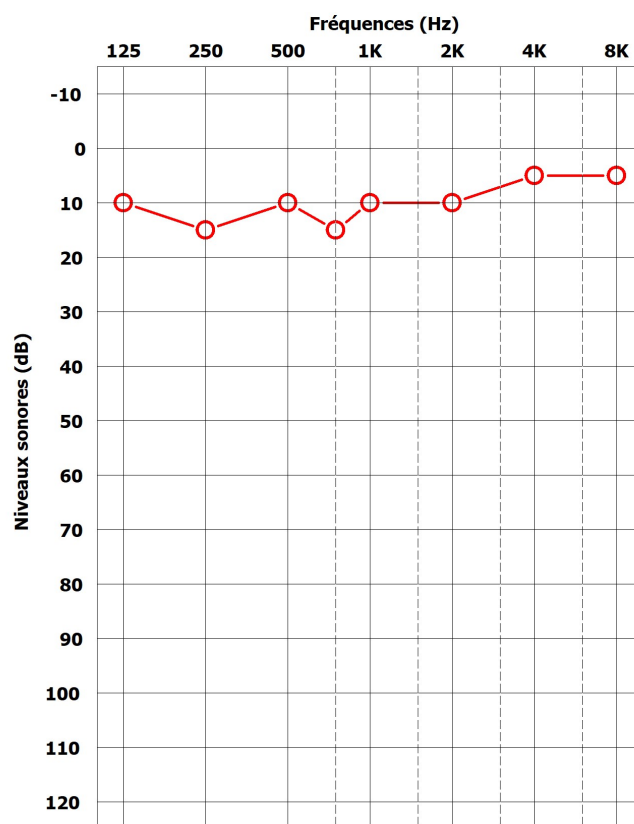

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	10	15	5	10		5		10		5
CA Droit	10	15	10	15	10		10		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes