


MEDVIE


Date du test: 01/05/2024 15:22:59

Durée: 8mn 02s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

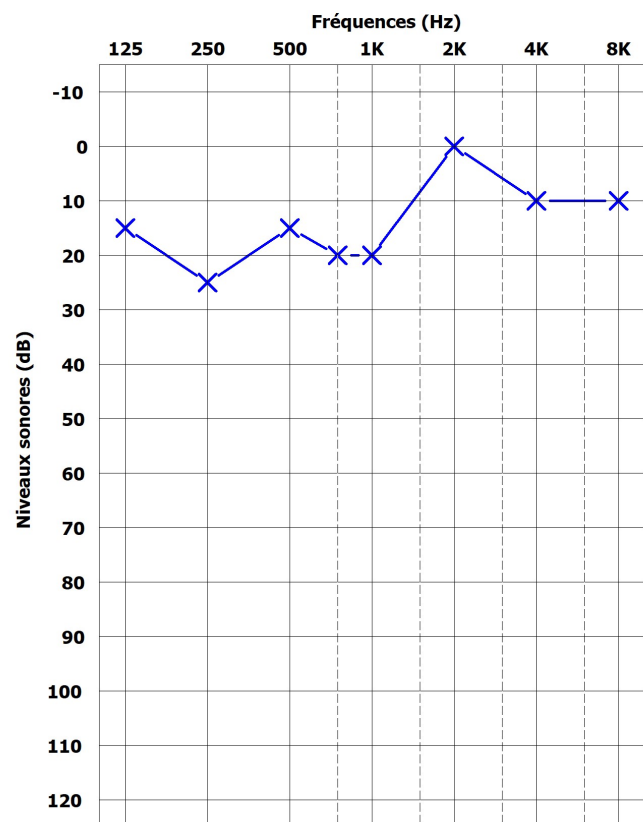

Oreille Gauche

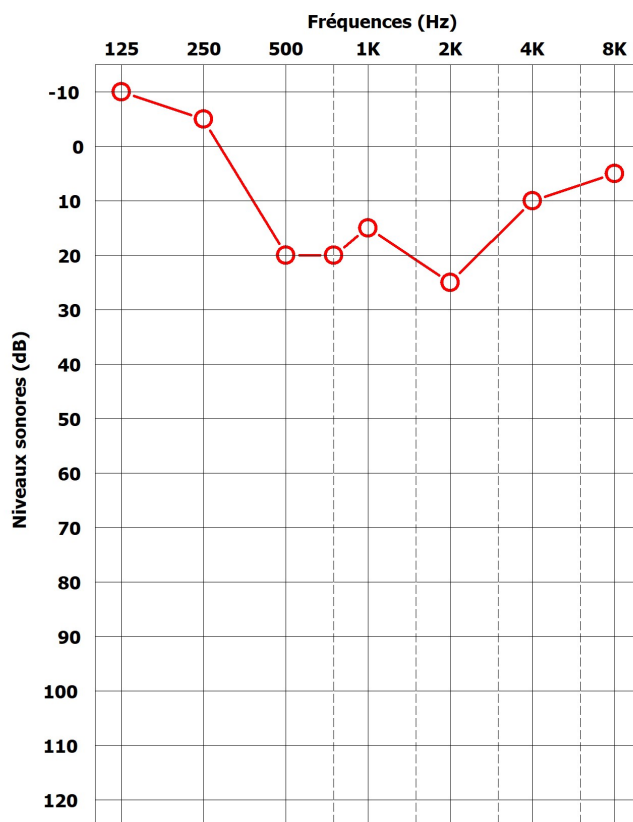

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	25	15	20	20		0		10		10
CA Droit	-10	-5	20	20	15		25		10		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes

Données Patient

CISSE SEKOU

Date de naissance

01/01/1984

Age

40

Société

CR18

ID

24050115183113746

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021