

MEDVIE


Date du test: 09/04/2025 15:39:46

Durée: 4mn 43s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KEITA MORY
Date de naissance	01/01/1988
Age	37
Société	CR18
ID	25040915344264282

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

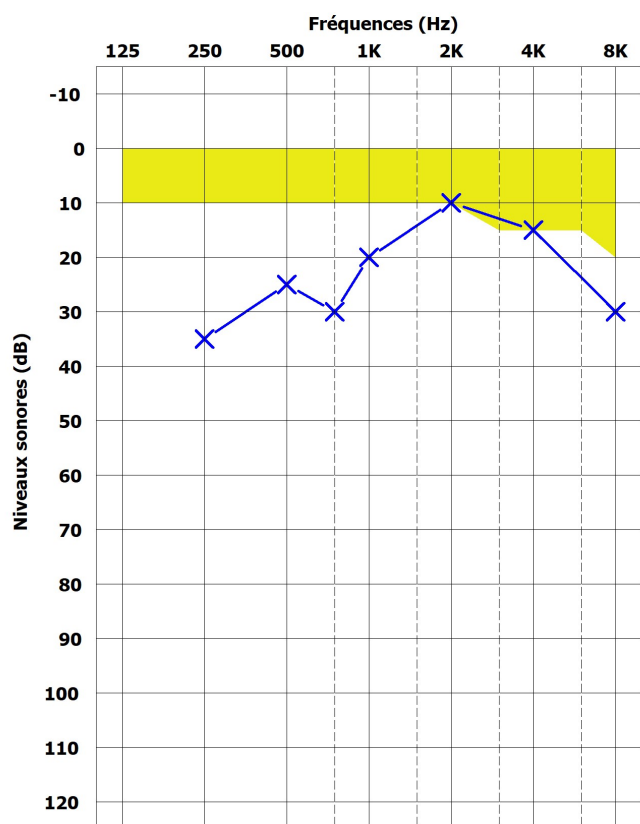

Oreille Gauche

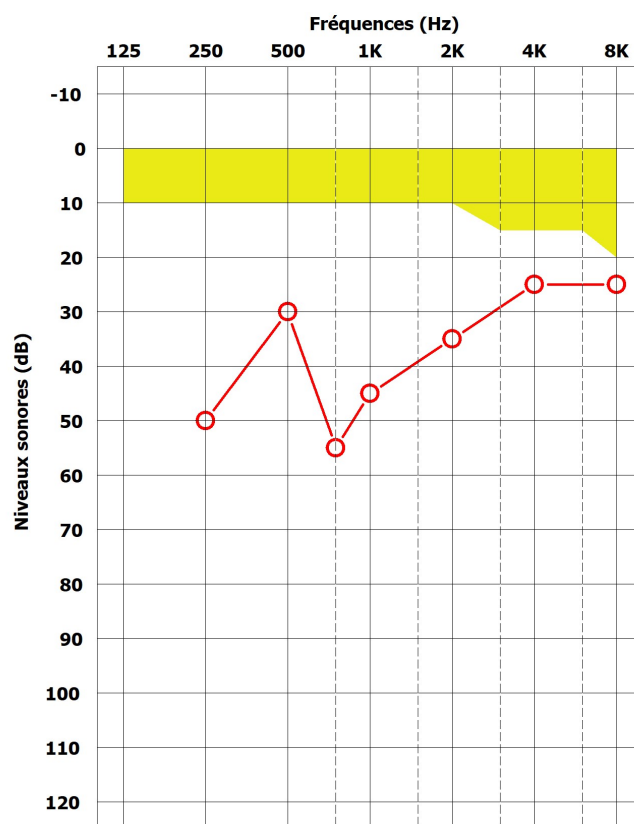

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	25	30	20		10		15		30
CA Droit		50	30	55	45		35		25		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	33,8 dB	---

Notes