


MEDVIE


Date du test: 17/05/2024 14:14:08
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient		BAMBA LAYE
Date de naissance	01/01/1976	
Age	48	
Société	CR18	
ID	24051714110160582	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

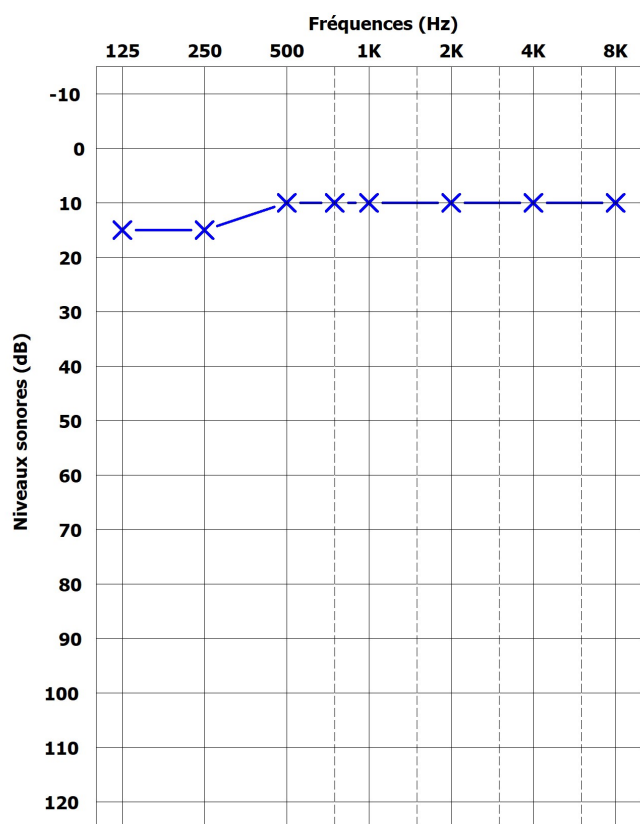

Oreille Gauche

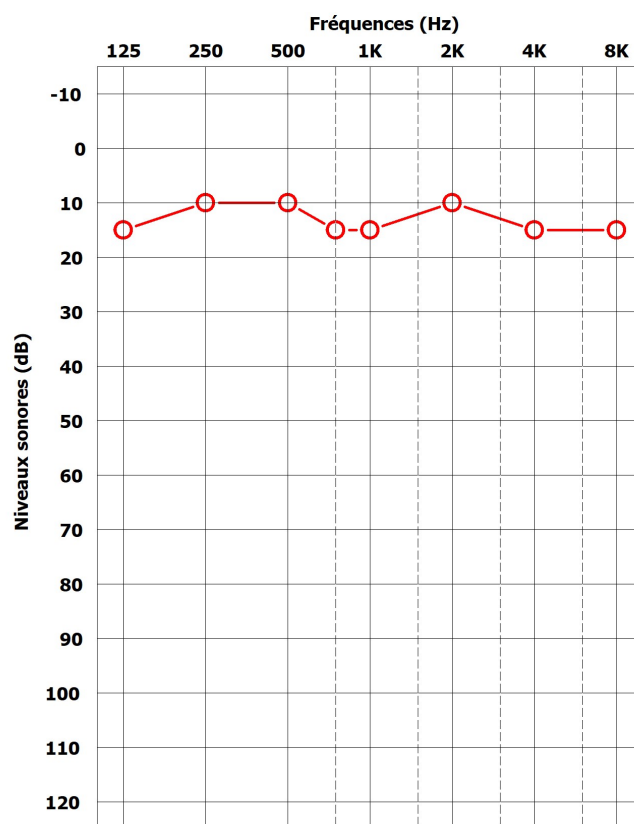

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	15	10	10	10		10		10		10
CA Droit	15	10	10	15	15		10		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes