

MEDVIE

Date du test: 01/10/2024 13:56:43

Durée: 4mn 15s

Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

Données Patient

**BAH BOUBACAR**

Date de naissance 31/05/2001

Age 23

Société CR18


ID 24100113541741471

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021

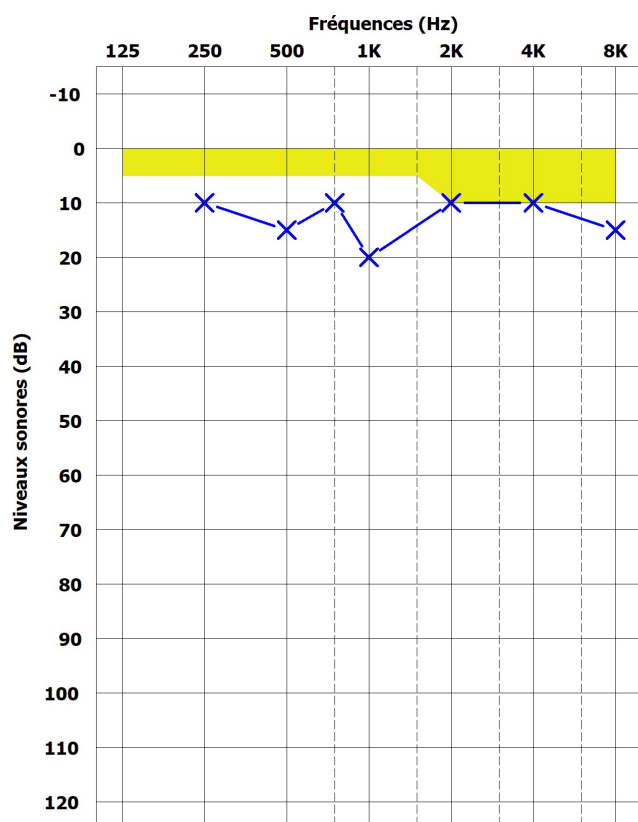

Oreille Gauche

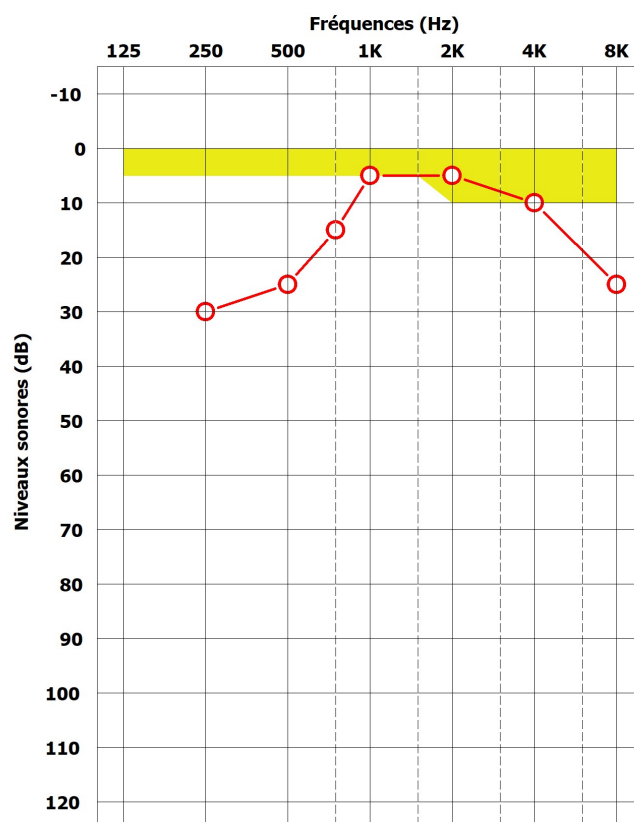

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 10  | 15  | 10  | 20 |     | 10 |    | 10 |    | 15 |
| CA Droit  |     | 30  | 25  | 15  | 5  |     | 5  |    | 10 |    | 25 |

Calcul de perte

|           | PAM     | IPA |
|-----------|---------|-----|
| CA Gauche | 13,8 dB | --- |
| CA Droit  | 11,3 dB | --- |

Notes