



| Données Patient   |  | YUAN QINGMIN      |
|-------------------|--|-------------------|
| Date de naissance |  | 05/08/1987        |
| Age               |  | 37                |
| Société           |  | CR18              |
| ID                |  | 25062315392160214 |

Date du test: 23/06/2025 15:43:28  
Durée: 4mn 32s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

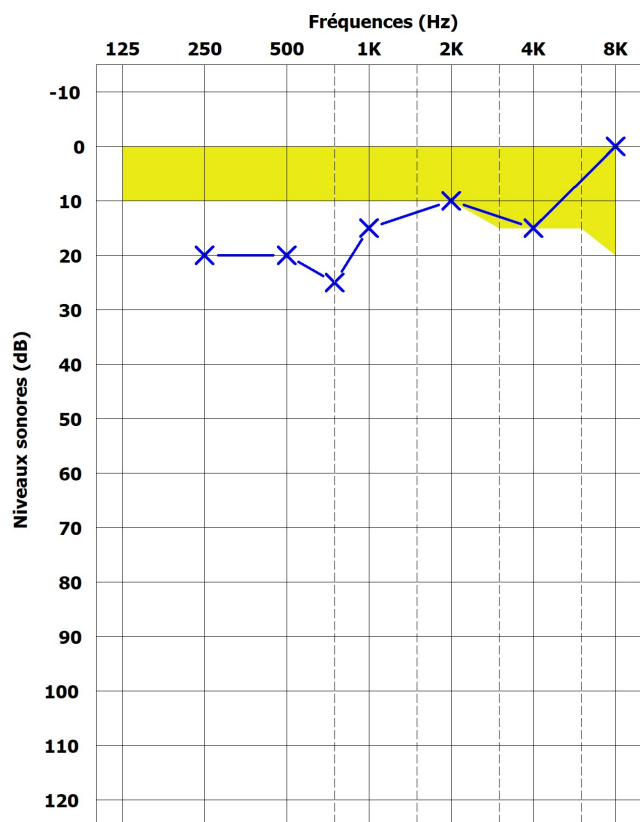

Oreille Gauche

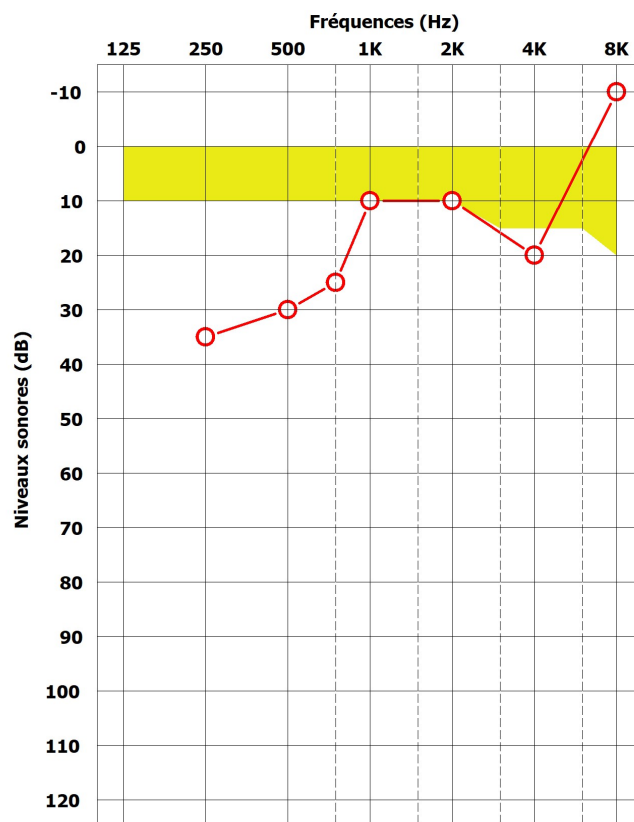

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|
| CA Gauche |     | 20  | 20  | 25  | 15 |     | 10 |    | 15 |    | 0   |
| CA Droit  |     | 35  | 30  | 25  | 10 |     | 10 |    | 20 |    | -10 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 15,0 dB | --- |
| CA Droit        | 17,5 dB | --- |

Notes