


MEDVIE

Date du test: 24/04/2024 15:02:58

Durée: 6mn 31s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

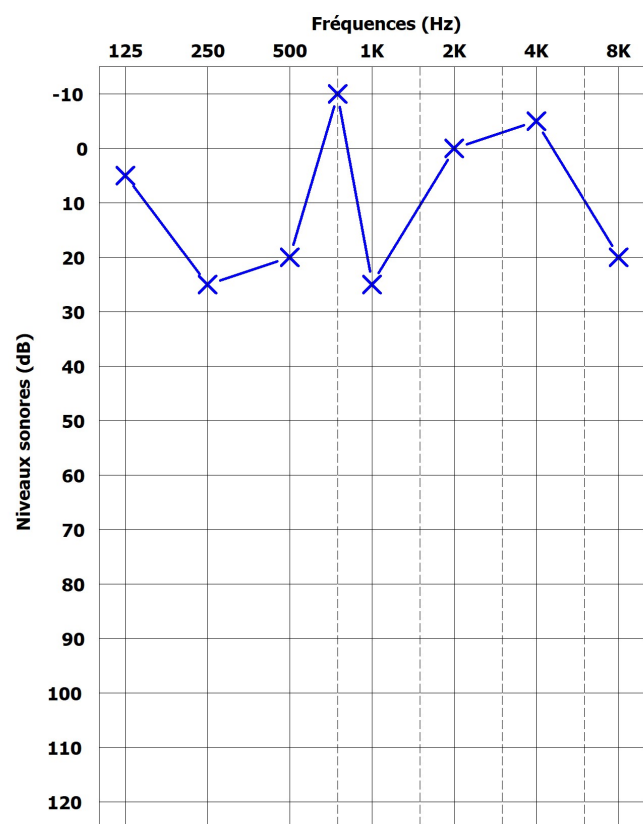

Oreille Gauche

Données Patient		BAMBA SENY
Date de naissance	01/01/2002	
Age	22	
Société	CR18	
ID	24042414581202278	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

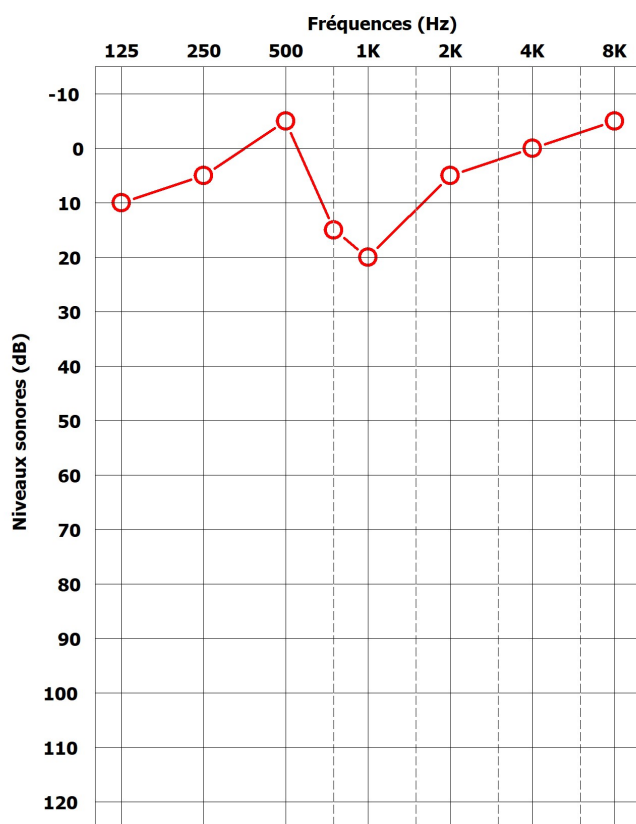

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	5	25	20	-10	25		0		-5		20
CA Droit	10	5	-5	15	20		5		0		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes