


MEDVIE


Date du test: 25/08/2025 15:15:43

Durée: 5mn 52s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

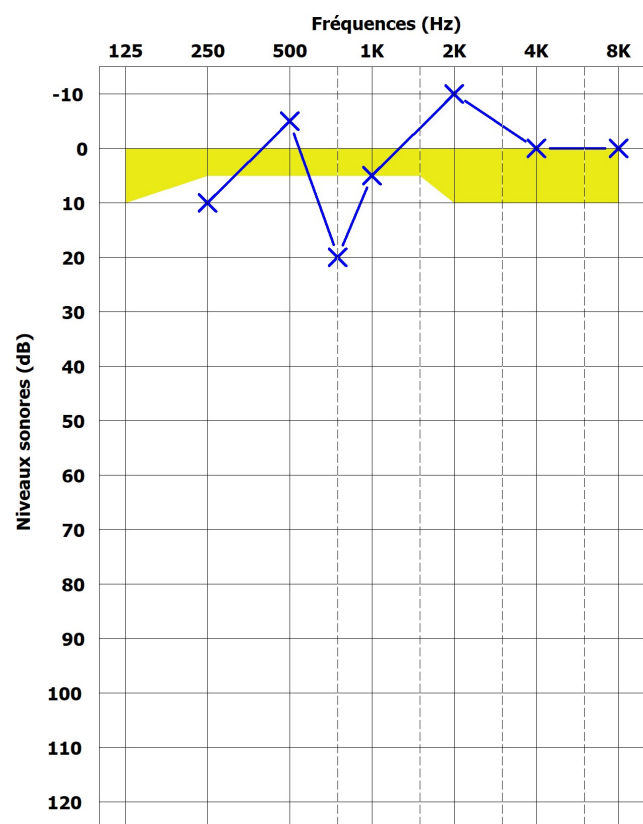

Oreille Gauche

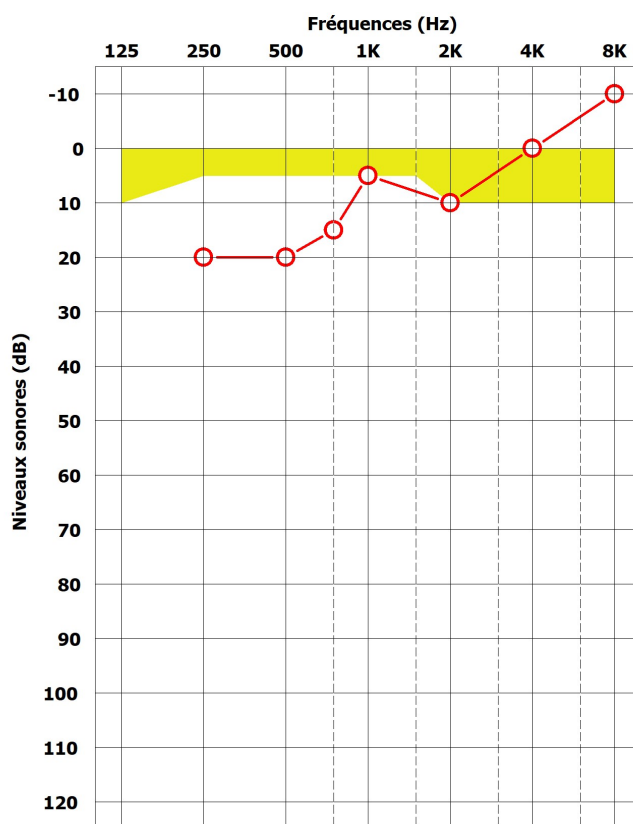

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	-5	20	5		-10		0		0
CA Droit		20	20	15	5		10		0		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-2,5 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA SEKOU
Date de naissance	02/03/2000
Age	25
Société	CR18
ID	25082515131336927

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021