

MEDVIE


Date du test: 05/07/2025 12:19:45

Durée: 5mn 03s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		LI XIANG
Date de naissance		03/05/1992
Age		33
Société		CR18
ID		25070511191438813

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

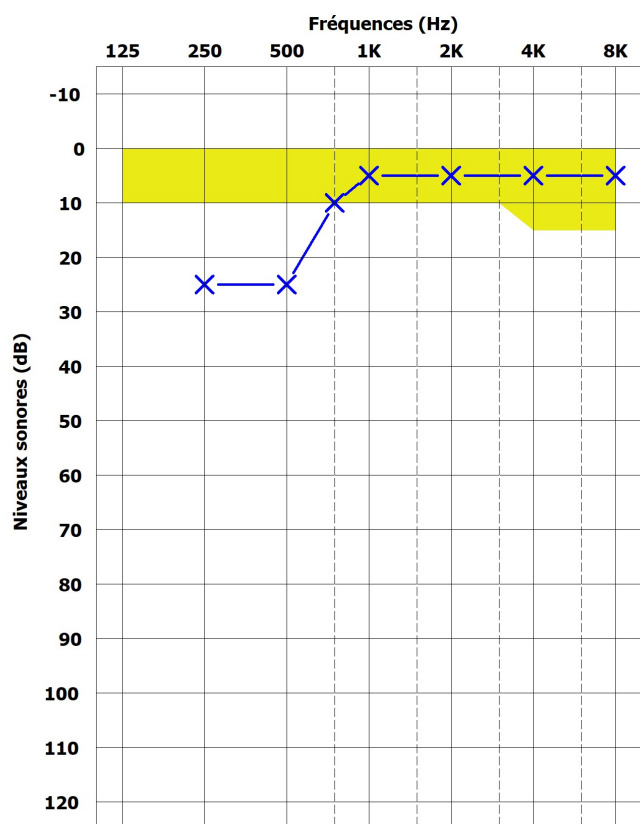

Oreille Gauche

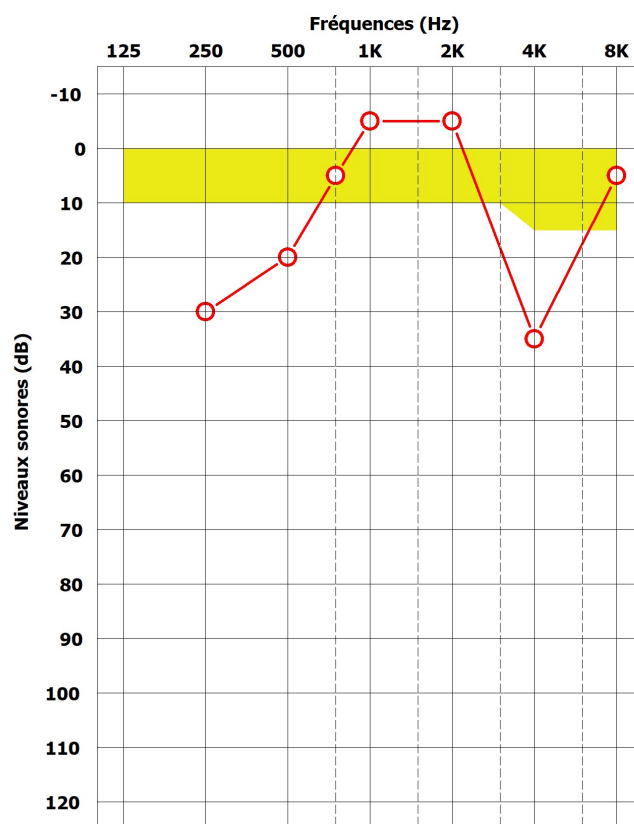

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	10	5		5		5		5
CA Droit		30	20	5	-5		-5		35		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes