


MEDVIE


Date du test: 18/07/2025 16:09:27
Durée: 8mn 09s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO OUMAR SADJO	
Date de naissance	01/01/1988
Age	37
Société	CR18
ID	25071813343769126

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

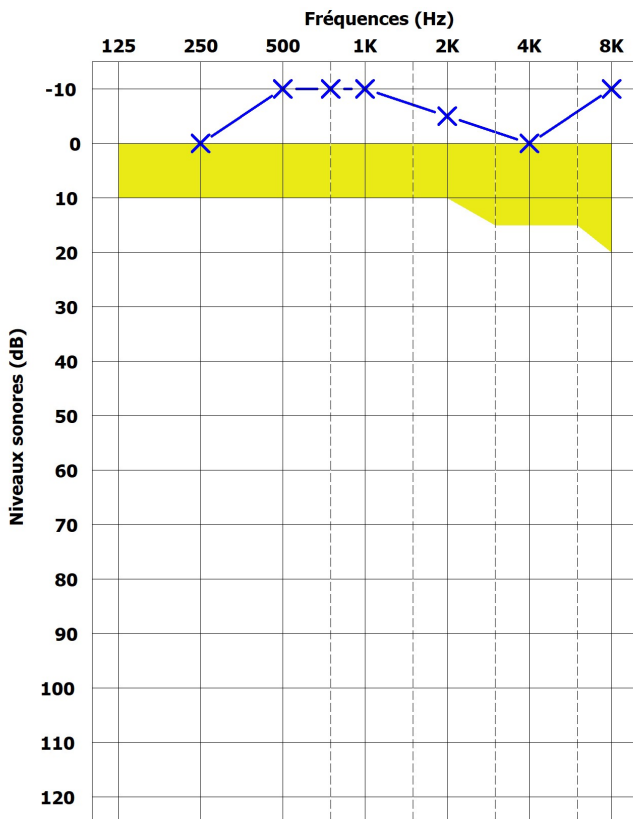

Oreille Gauche

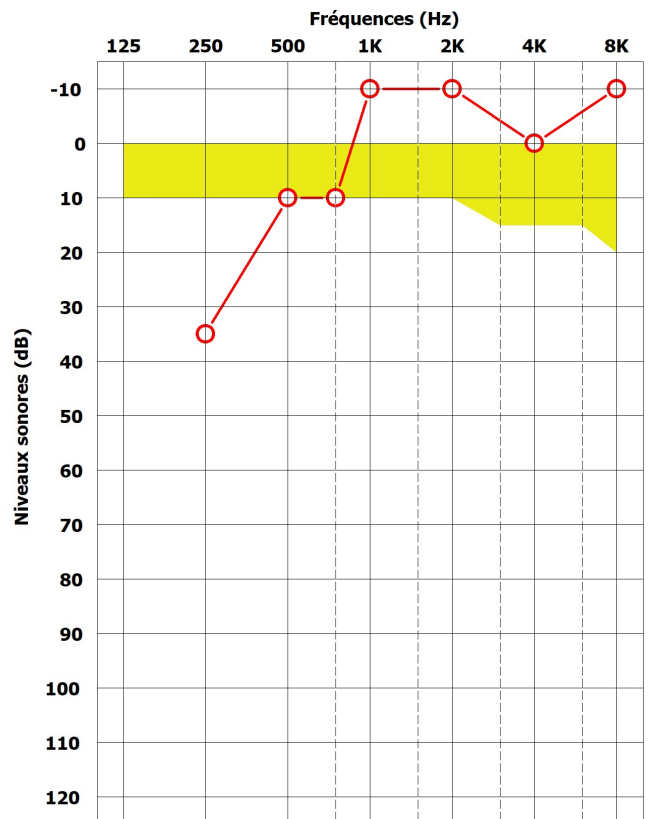

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	-10	-10	-10		-5		0		-10
CA Droit		35	10	10	-10		-10		0		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-6,3 dB	---
CA Droit	-2,5 dB	---

Notes