

MEDVIE


Date du test: 29/04/2024 17:43:19

Durée: 12mn 43s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	BAMBA SERIMA
Date de naissance	21/01/1990
Age	34
Société	CR18
ID	24042917401592445

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

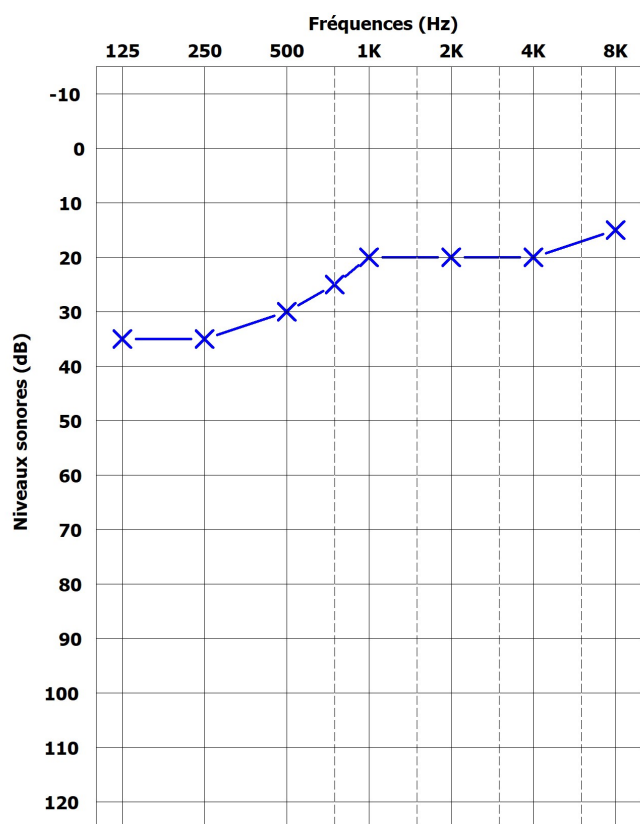

Oreille Gauche

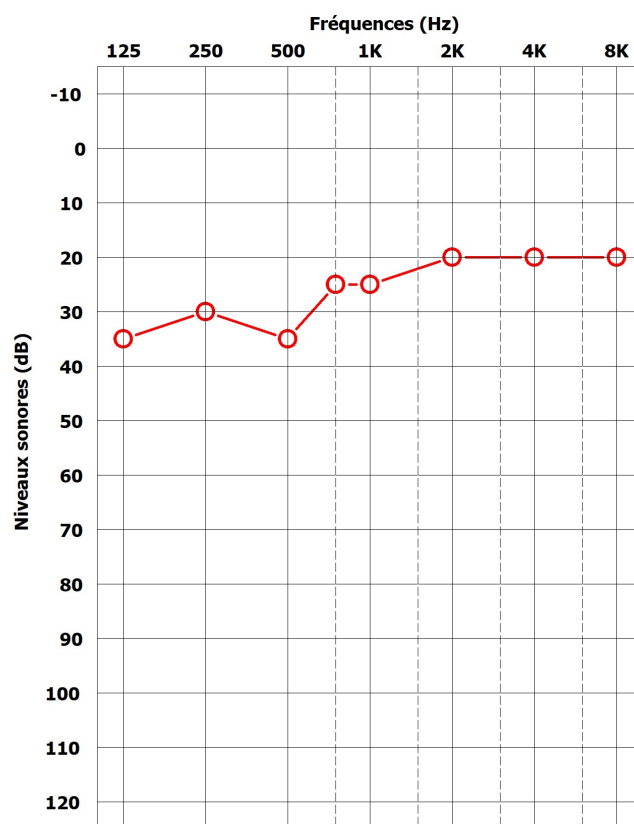

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	35	30	25	20		20		20		15
CA Droit	35	30	35	25	25		20		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	25,0 dB	---

Notes