


MEDVIE

Date du test: 20/07/2024 13:01:48

Durée: 5mn 56s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

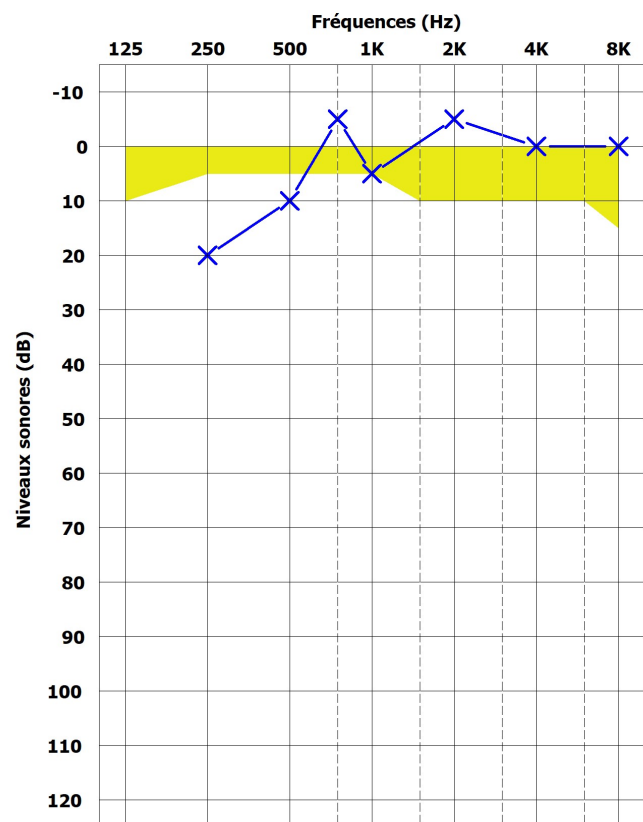

Oreille Gauche

| Données Patient   |                   | SAGNO YENE |
|-------------------|-------------------|------------|
| Date de naissance | 21/03/1995        |            |
| Age               | 29                |            |
| Société           | CEMED             |            |
| ID                | 24072012593228485 |            |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

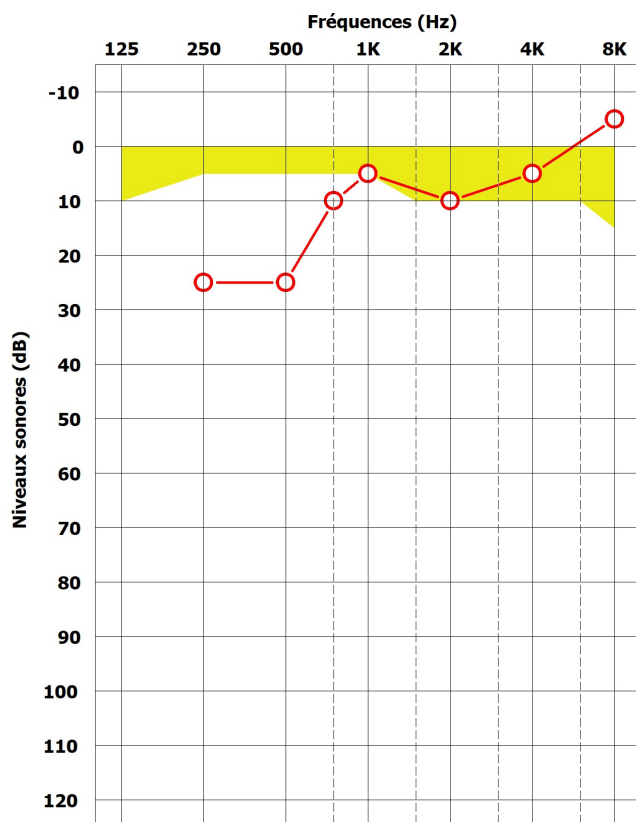

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 20  | 10  | -5  | 5  |     | -5 |    | 0  |    | 0  |
| CA Droit  |     | 25  | 25  | 10  | 5  |     | 10 |    | 5  |    | -5 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 2,5 dB  | --- |
| CA Droit        | 11,3 dB | --- |

Notes