


MEDVIE


Date du test: 22/04/2025 10:15:14
Durée: 5mn 06s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BINWE JEAN BAPTISTE	
Date de naissance	01/01/1990
Age	35
Société	CEMED
ID	25042210114965691

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

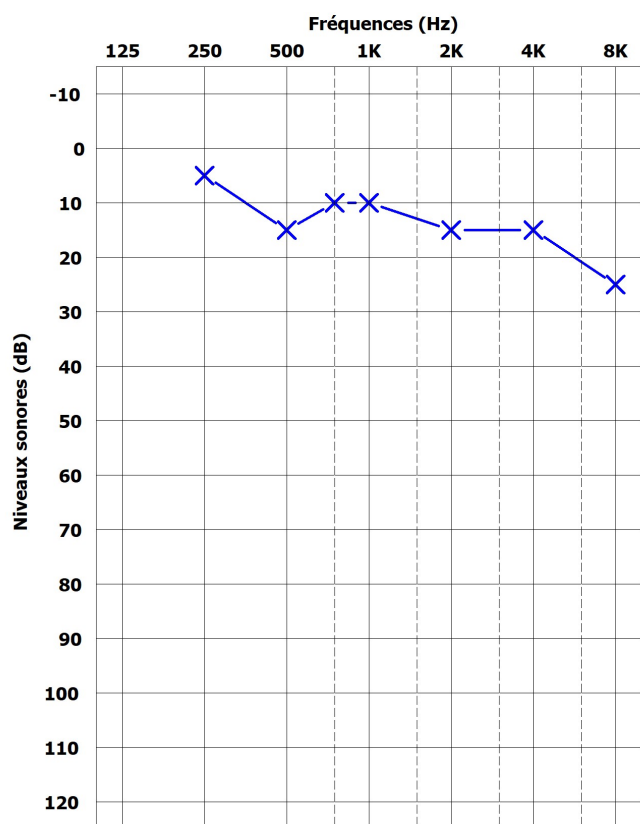

Oreille Gauche

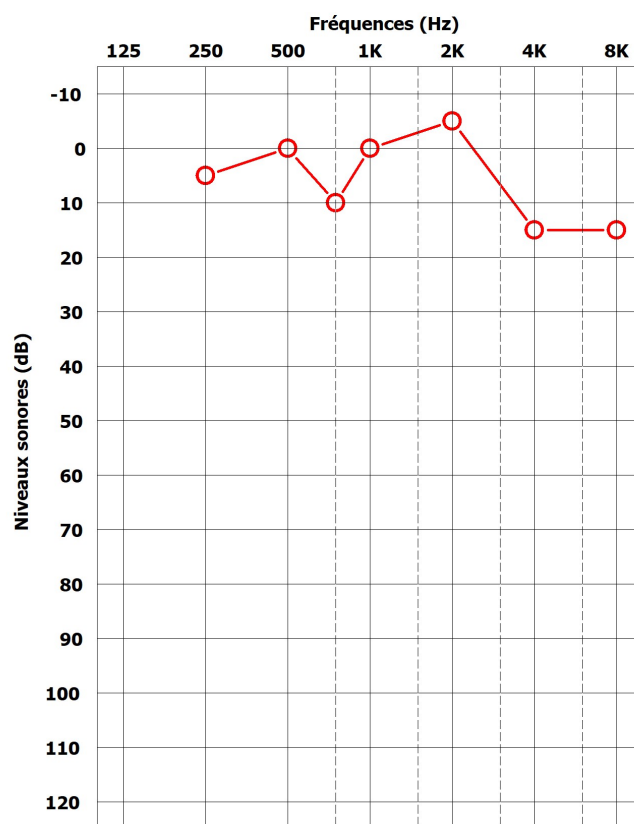

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	15	10	10		15		15		25
CA Droit		5	0	10	0		-5		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes