


MEDVIE

Date du test: 19/05/2025 10:47:48

Durée: 5mn 48s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

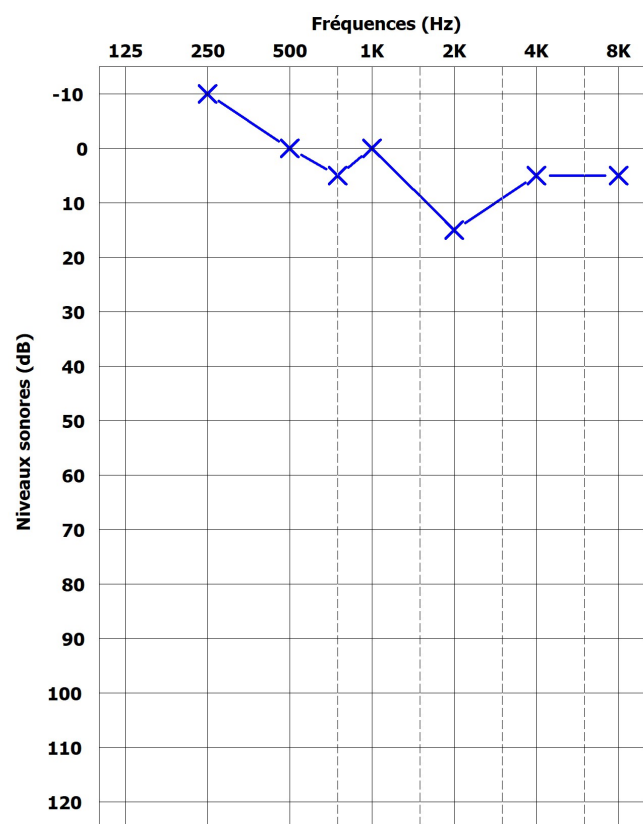

Oreille Gauche

| Données Patient   |                   | NGOUH AMADOU |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Date de naissance | 31/08/1989        |              |
| Age               | 35                |              |
| Société           | CEMED             |              |
| ID                | 25051910254528088 |              |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

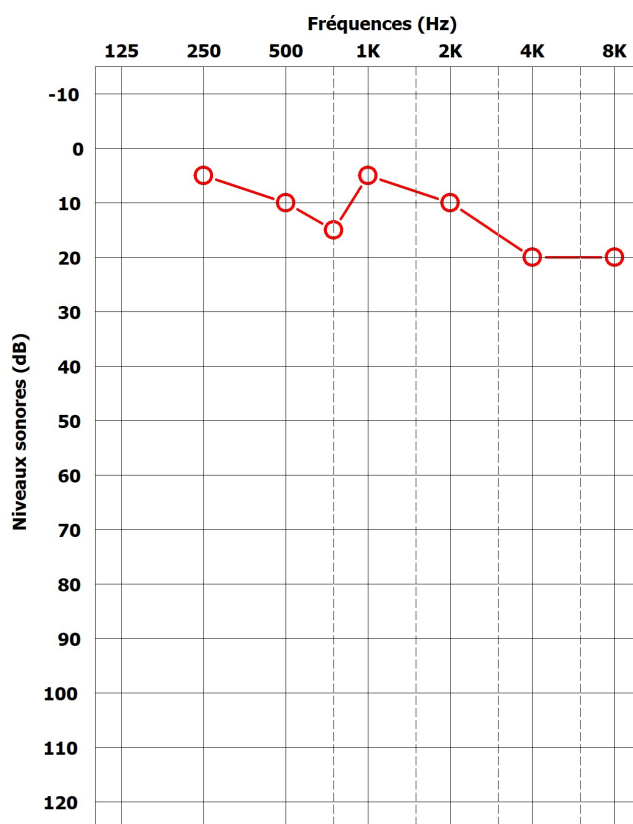

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | -10 | 0   | 5   | 0  |     | 15 |    | 5  |    | 5  |
| CA Droit  |     | 5   | 10  | 15  | 5  |     | 10 |    | 20 |    | 20 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 5,0 dB  | --- |
| CA Droit        | 11,3 dB | --- |

Notes