


MEDVIE


Date du test: 20/07/2024 12:42:42

Durée: 5mn 12s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

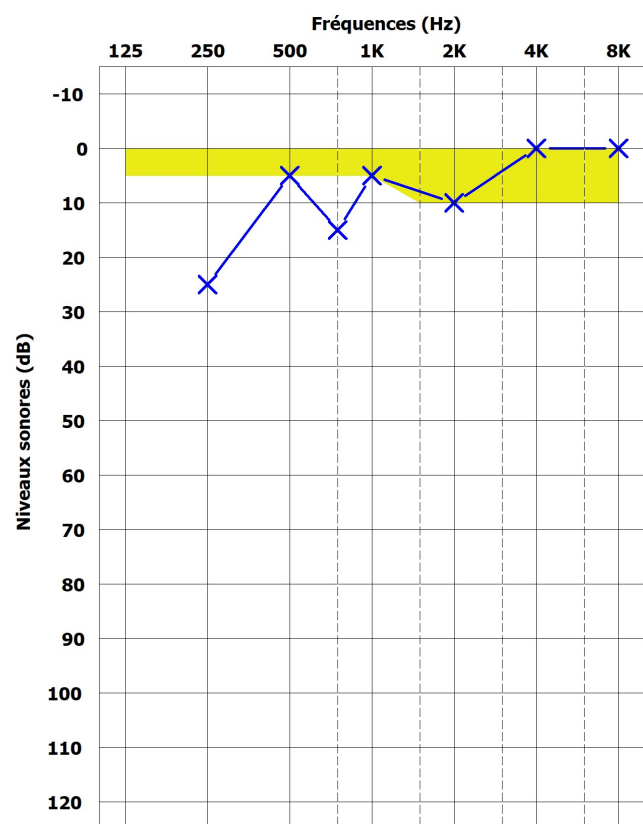

Oreille Gauche

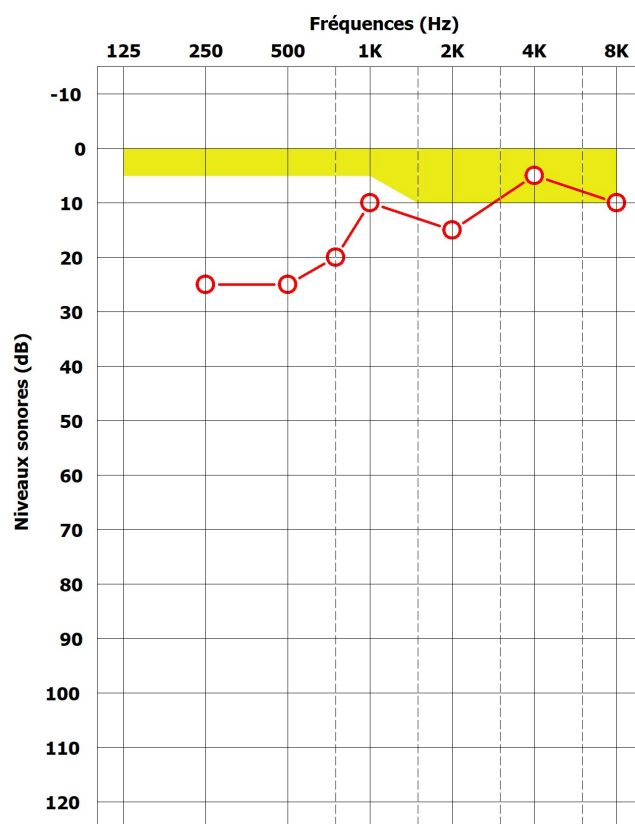

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	5	15	5		10		0		0
CA Droit		25	25	20	10		15		5		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes

Données Patient	HABA FELICITE AGNES
Date de naissance	06/07/1996
Age	28
Société	CEMED
ID	24072012384876457

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021