


MEDVIE


Date du test: 07/10/2024 13:45:39
Durée: 5mn 19s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIAKITE ABOUBACAR	
Date de naissance	16/01/1989
Age	35
Société	CEGEDI
ID	24100713430560890

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

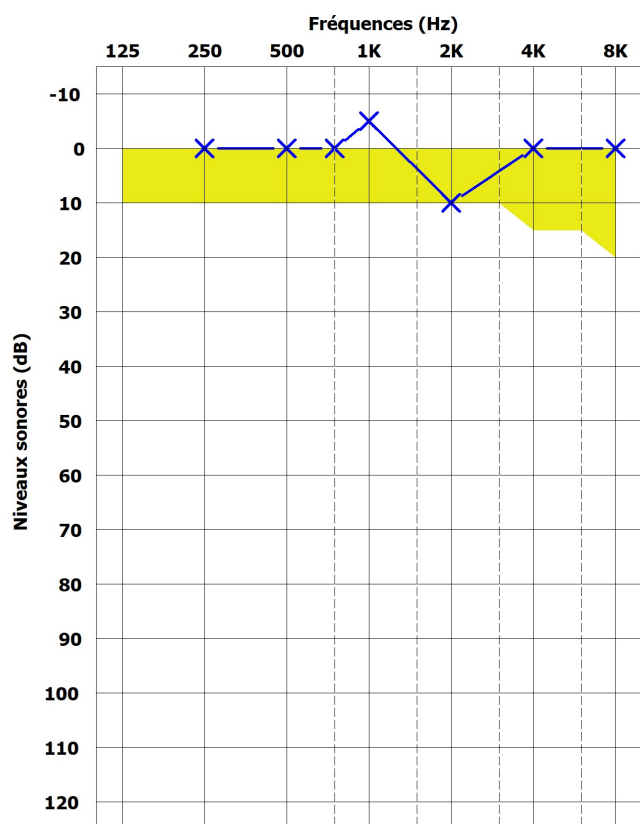

Oreille Gauche

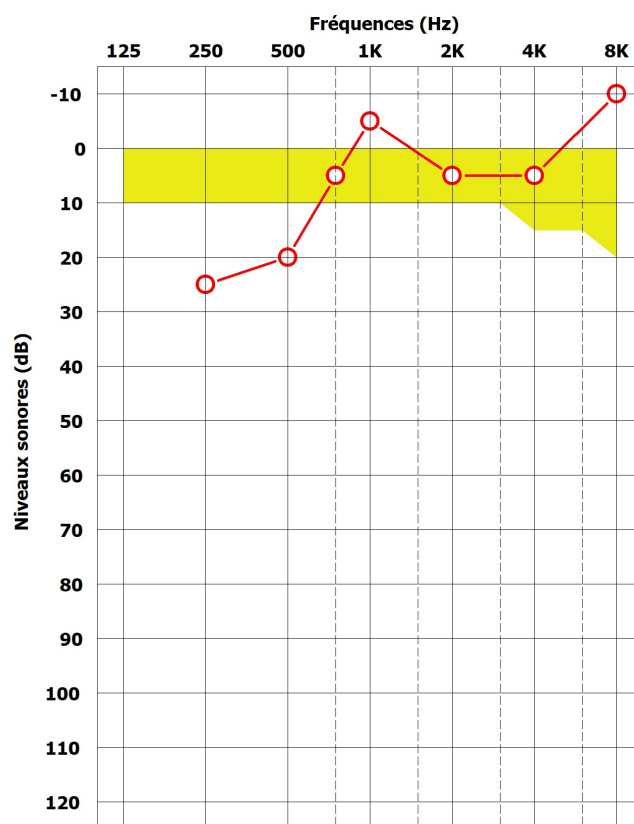

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	0	0	-5		10		0		0
CA Droit		25	20	5	-5		5		5		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	1,3 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes