


MEDVIE


Date du test: 29/08/2025 12:05:59
Durée: 3mn 44s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SYLLA AMADOU D. I. O. I. I. D. F.
Date de naissance	01/01/2006
Age	19
Société	CEGEDI
ID	25082912030475275

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

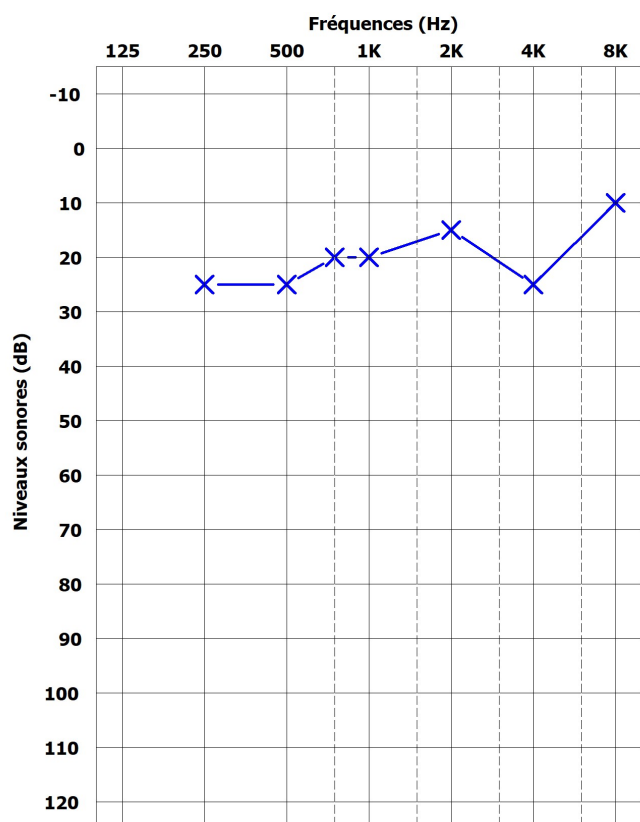

Oreille Gauche

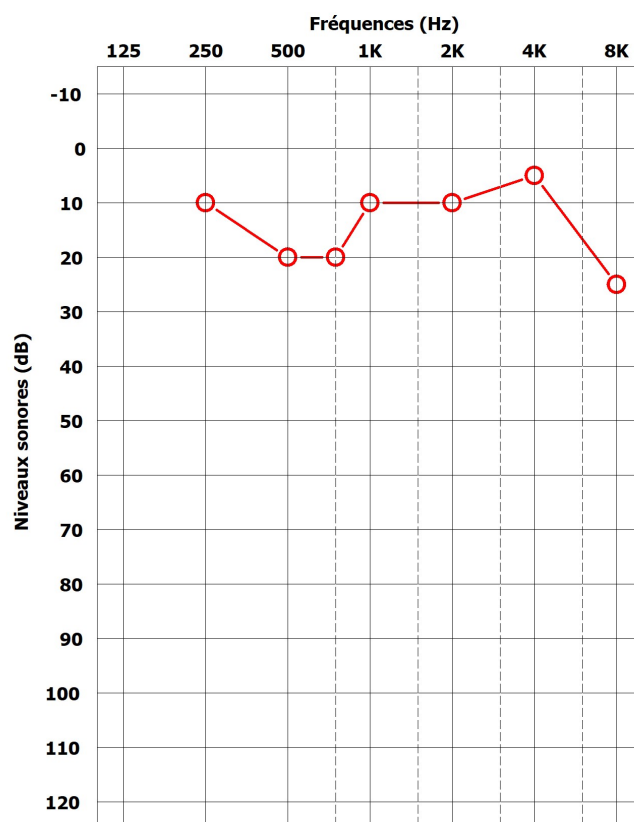

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	20	20		15		25		10
CA Droit		10	20	20	10		10		5		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes