


MEDVIE


Date du test: 29/08/2025 13:30:34
Durée: 5mn 45s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO BOUBACAR	
Date de naissance	01/01/1995
Age	30
Société	CEGEDI
ID	25082913275061892

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

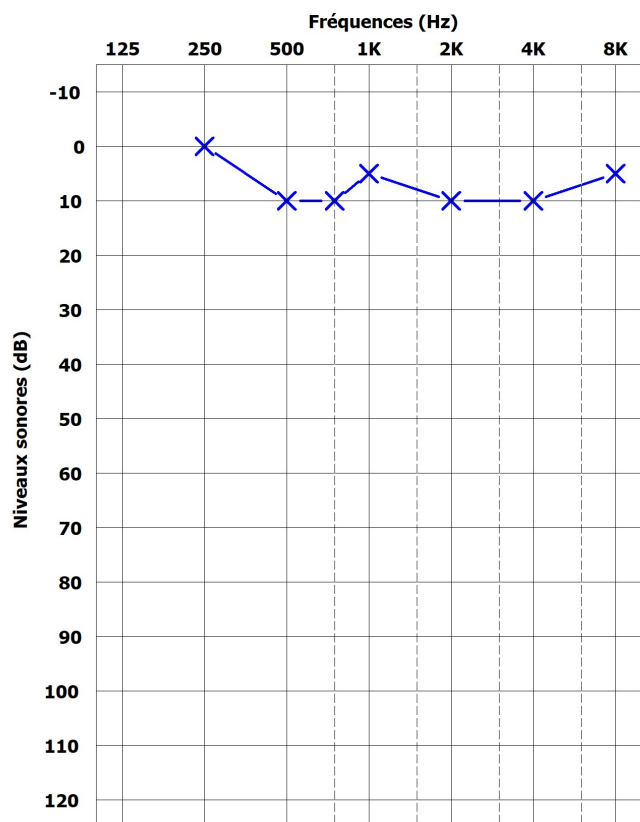

Oreille Gauche

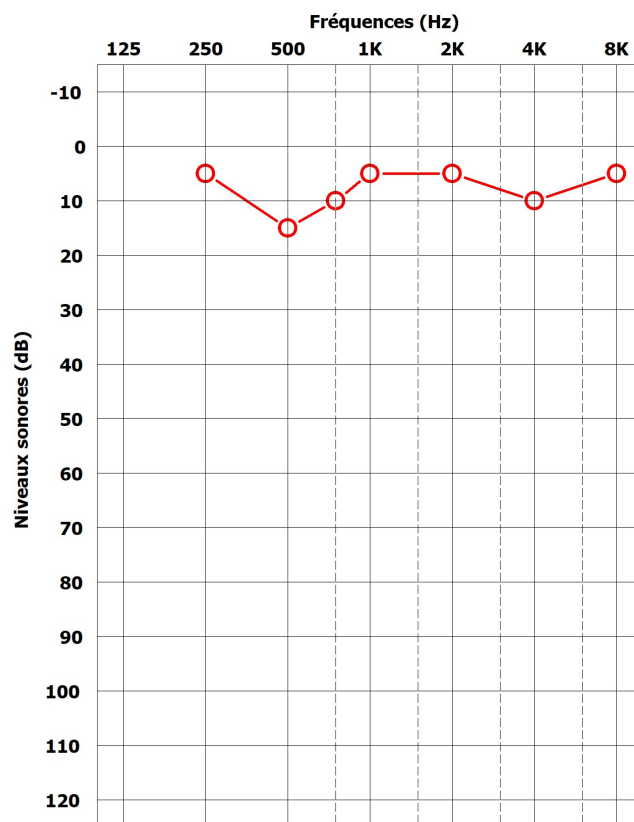

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	10	10	5		10		10		5
CA Droit		5	15	10	5		5		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes