

MEDVIE


Date du test: 11/03/2024 10:31:04

Durée: 9mn 23s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>BILIVOGUI BILIGUE</b> |                   |
| Date de naissance        | 01/01/1995        |
| Age                      | 29                |
| Société                  | CEGEDI            |
| ID                       | 24031110285773885 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

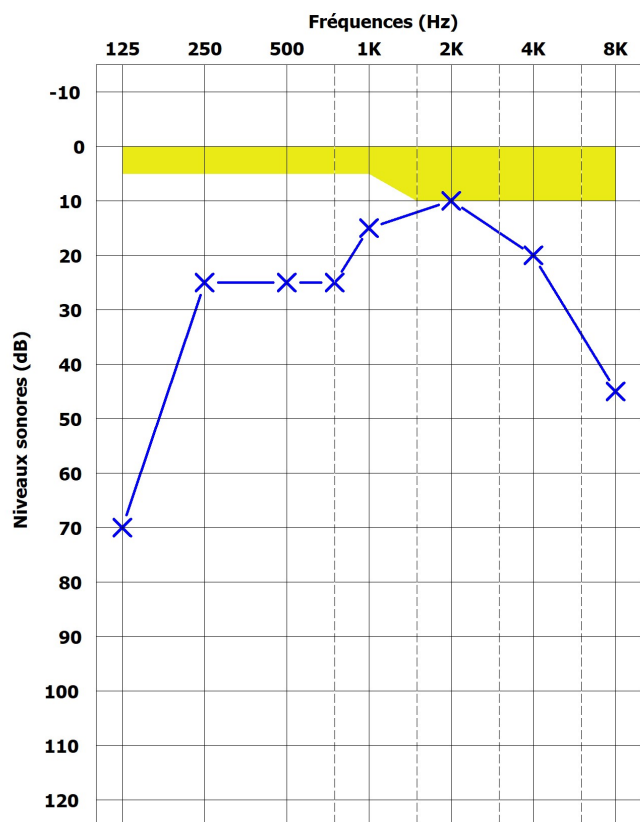

Oreille Gauche

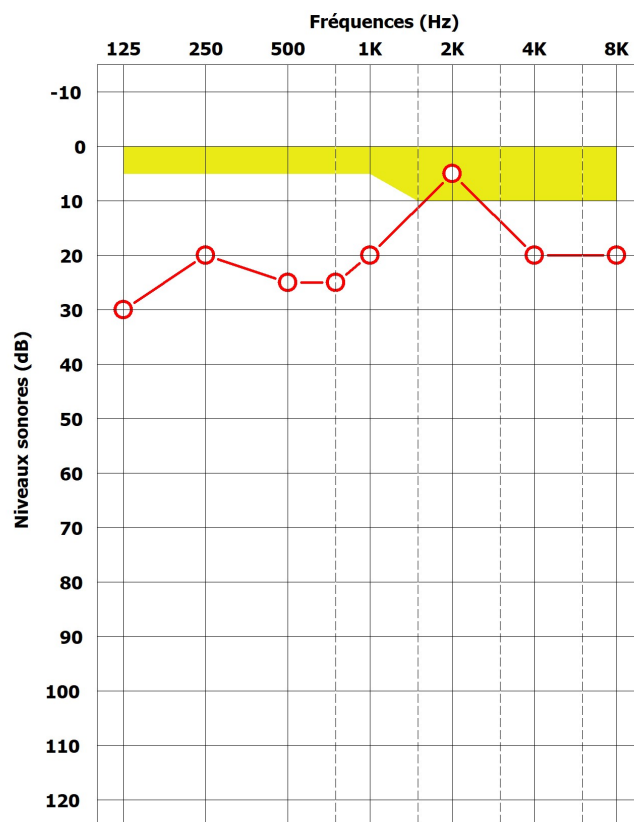

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 70  | 25  | 25  | 25  | 15 |     | 10 |    | 20 |    | 45 |
| CA Droit  | 30  | 20  | 25  | 25  | 20 |     | 5  |    | 20 |    | 20 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 17,5 dB | --- |
| CA Droit        | 17,5 dB | --- |

Notes