


MEDVIE


Date du test: 11/03/2024 10:44:25

Durée: 7mn 37s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

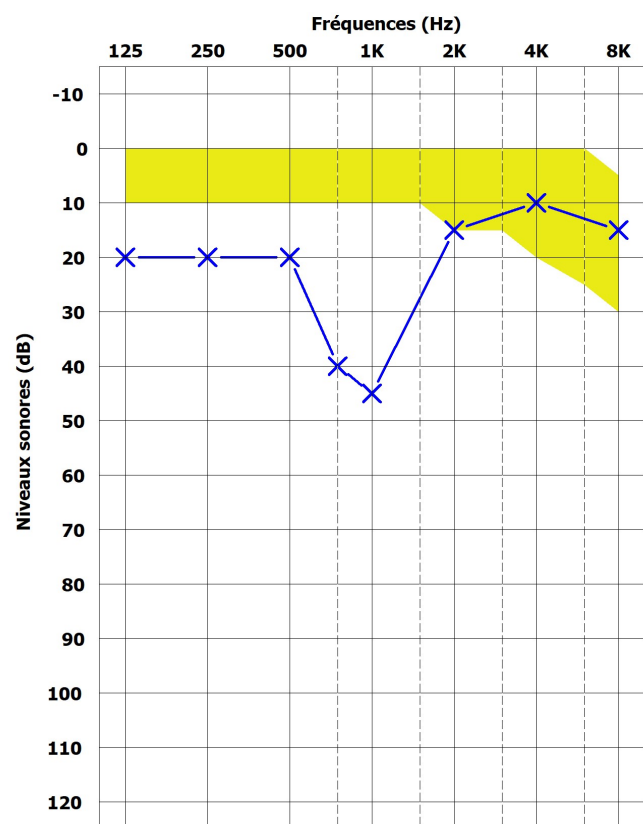

Oreille Gauche

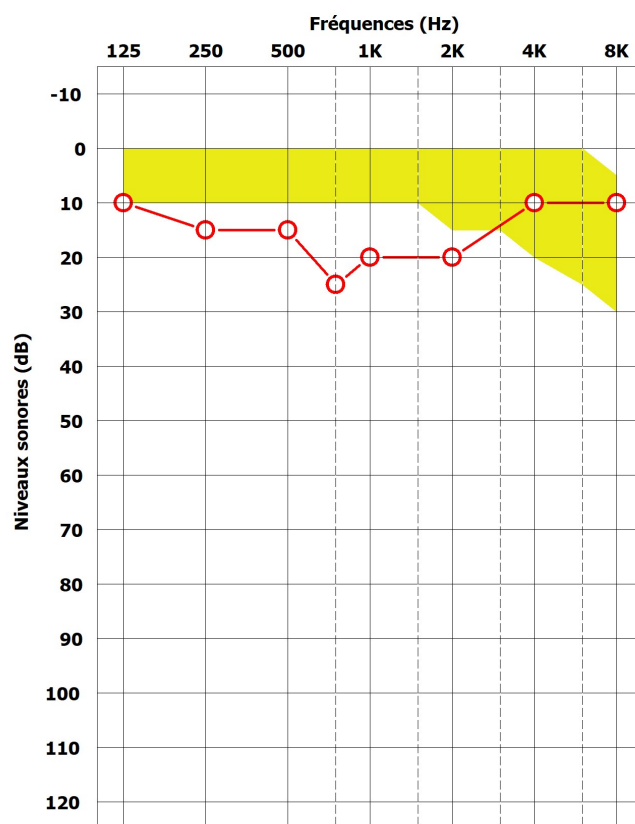

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	20	40	45		15		10		15
CA Droit	10	15	15	25	20		20		10		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes

Données Patient	BEKETE JACQUES NIARRA
Date de naissance	16/08/1980
Age	43
Société	CEGEDI
ID	24031110421348741

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021