

MEDVIE


Date du test: 29/08/2025 12:16:54

Durée: 4mn 28s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO BOUBACAR	
Date de naissance	20/02/2007
Age	18
Société	CEGEDI
ID	25082912144832653

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

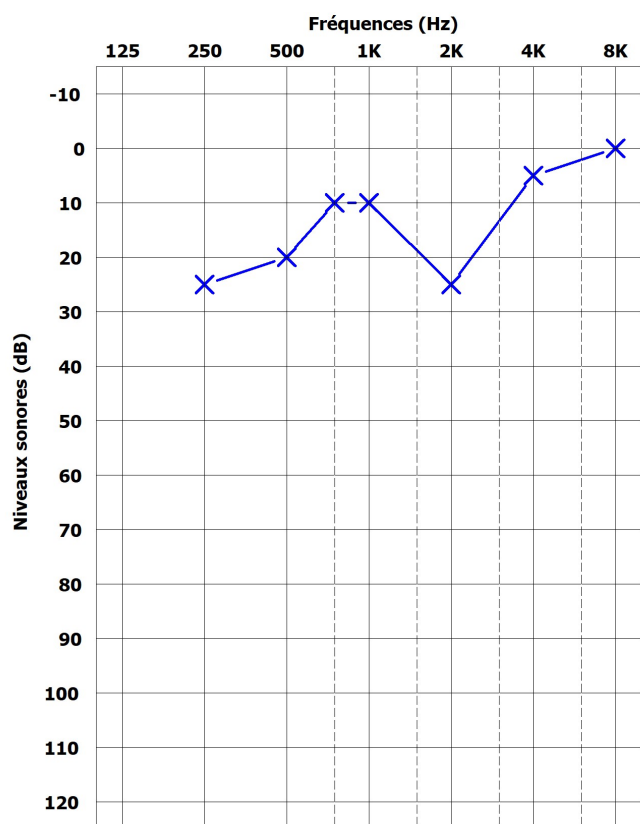

Oreille Gauche

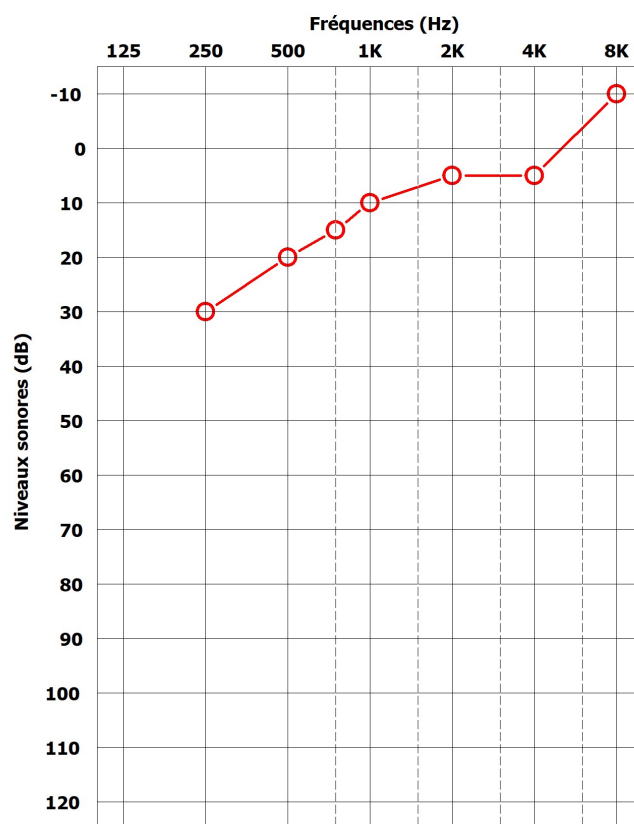

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	10	10		25		5		0
CA Droit		30	20	15	10		5		5		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes