


Données Patient	
DIALLO MAMADOU DIAO	
Date de naissance	01/11/1999
Age	25
Société	CEGEDI
ID	25082912544942703


MEDVIE

Date du test: 29/08/2025 12:56:46
 Durée: 5mn 28s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

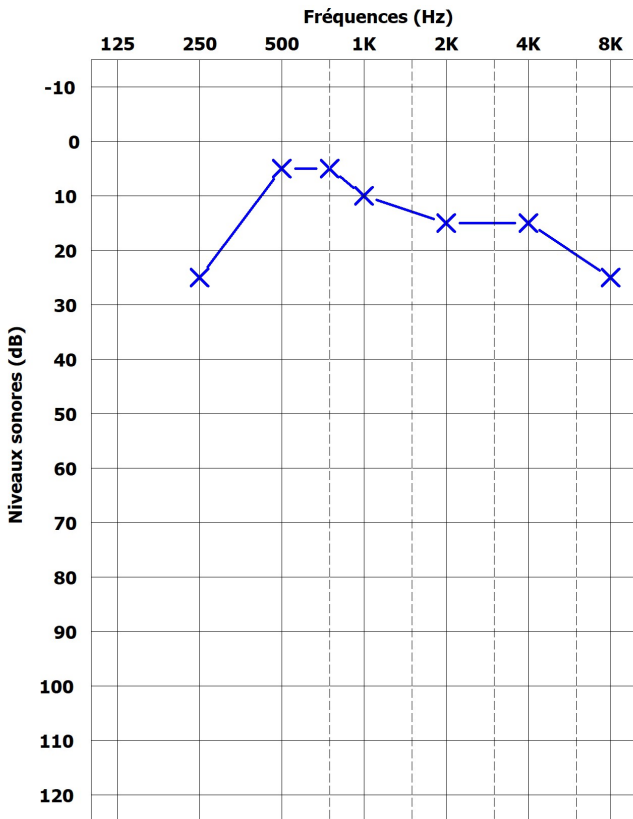

Oreille Gauche

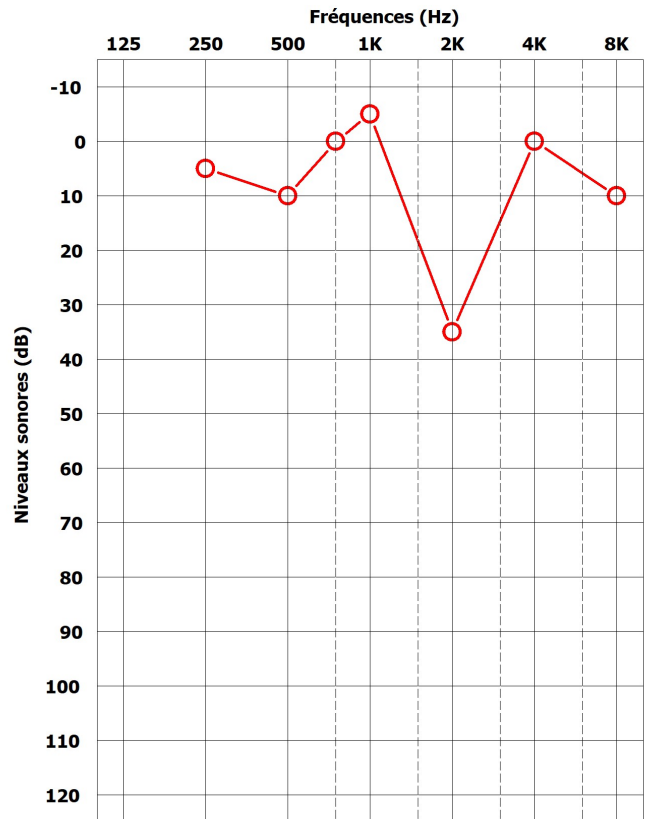

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	5	5	10		15		15		25
CA Droit		5	10	0	-5		35		0		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes