


MEDVIE


Date du test: 14/08/2024 13:53:08
Durée: 4mn 59s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOIVOGUI PROSPER SFKOII	
Date de naissance	03/06/1963
Age	61
Société	CEGEDI
ID	24081413332224073

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

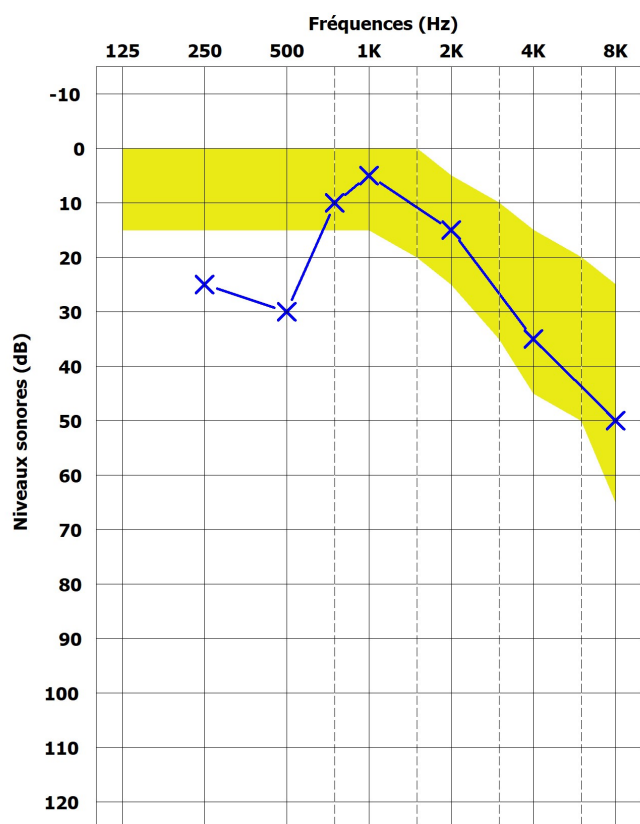

Oreille Gauche

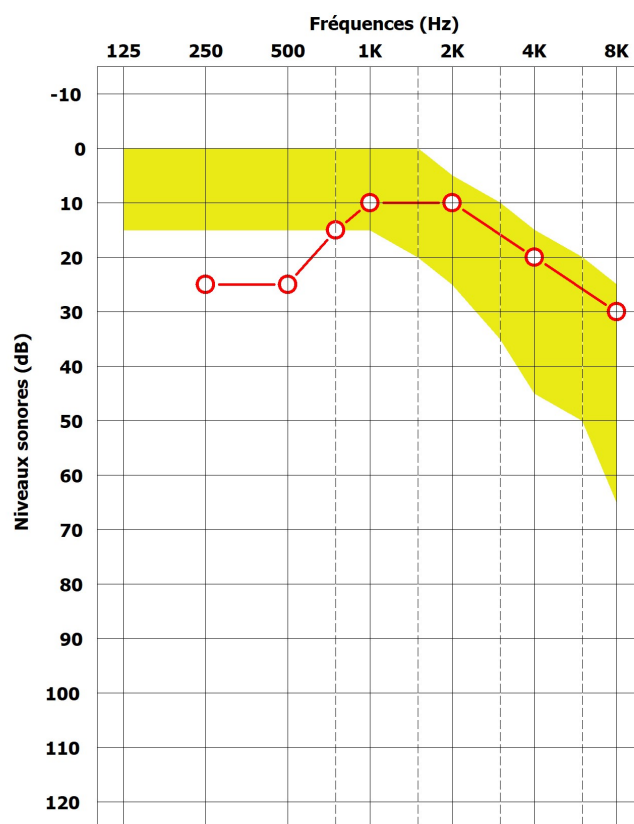

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	10	5		15		35		50
CA Droit		25	25	15	10		10		20		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes