

MEDVIE


Date du test: 20/03/2024 11:14:25

Durée: 9mn 34s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		TRAORE LAYE
Date de naissance	01/01/1989	
Age	35	
Société	GST	
ID	24032011111412826	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

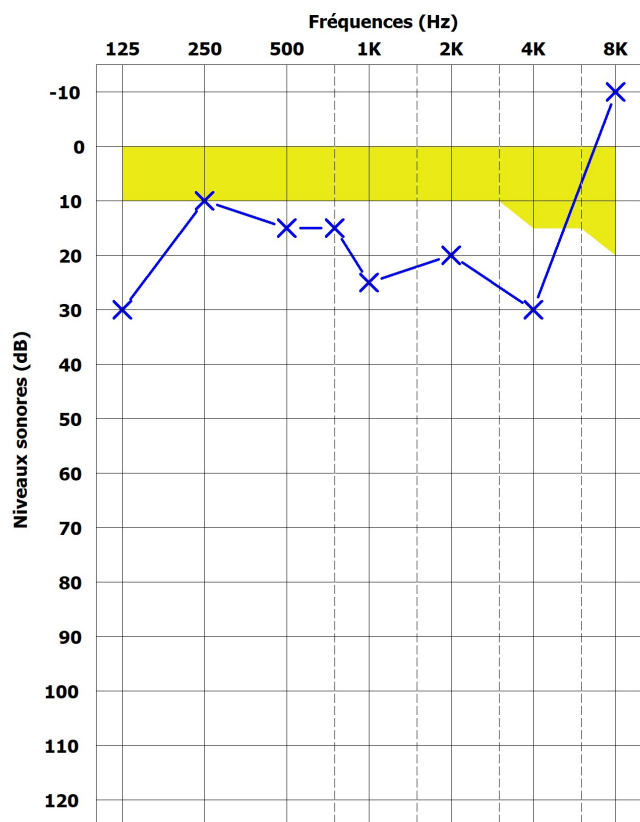

Oreille Gauche

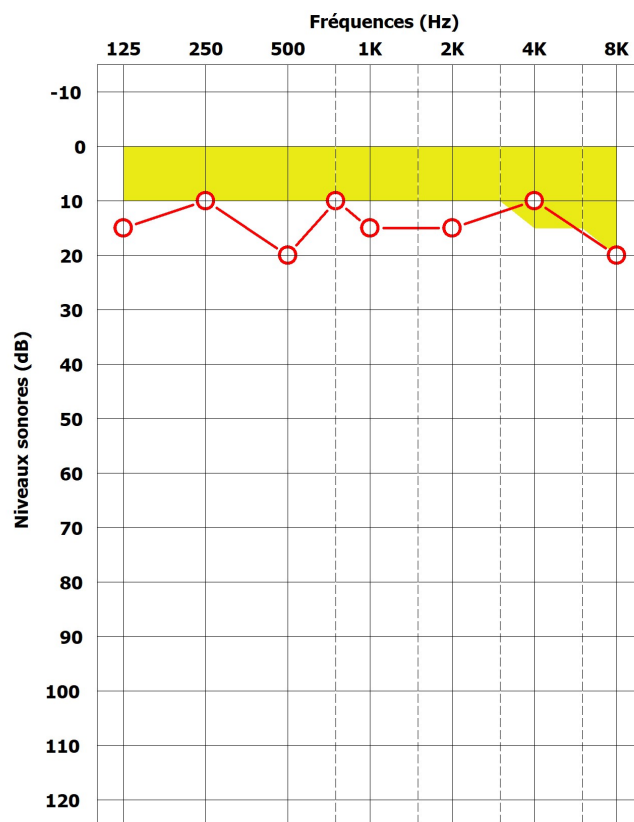

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	10	15	15	25		20		30		-10
CA Droit	15	10	20	10	15		15		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes