
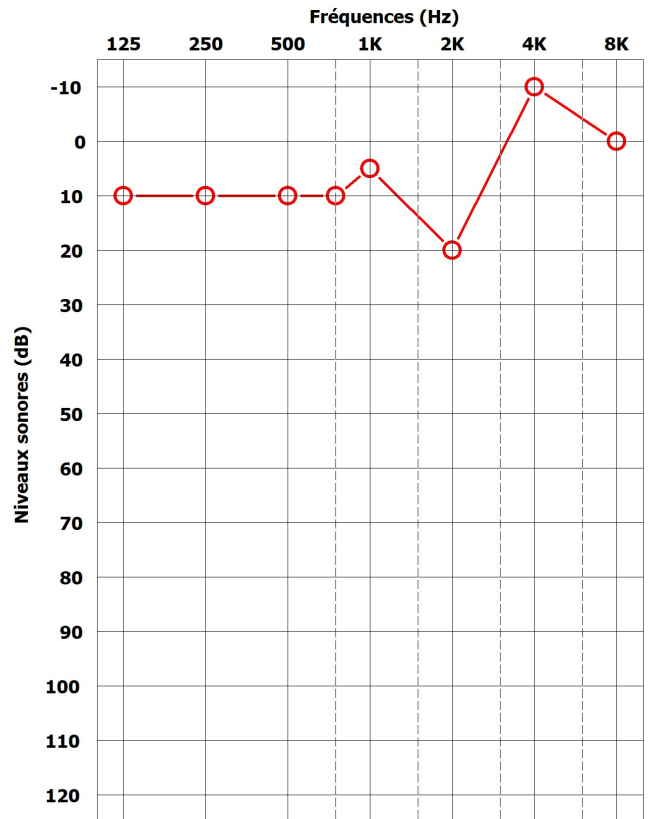


Données Patient		KEITA SIDIKI
Date de naissance	01/01/1999	
Age	25	
Société	GST	
ID	24032509353895025	

MEDVIE

Date du test: 09/04/2024 13:27:16
 Durée: 7mn 38s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

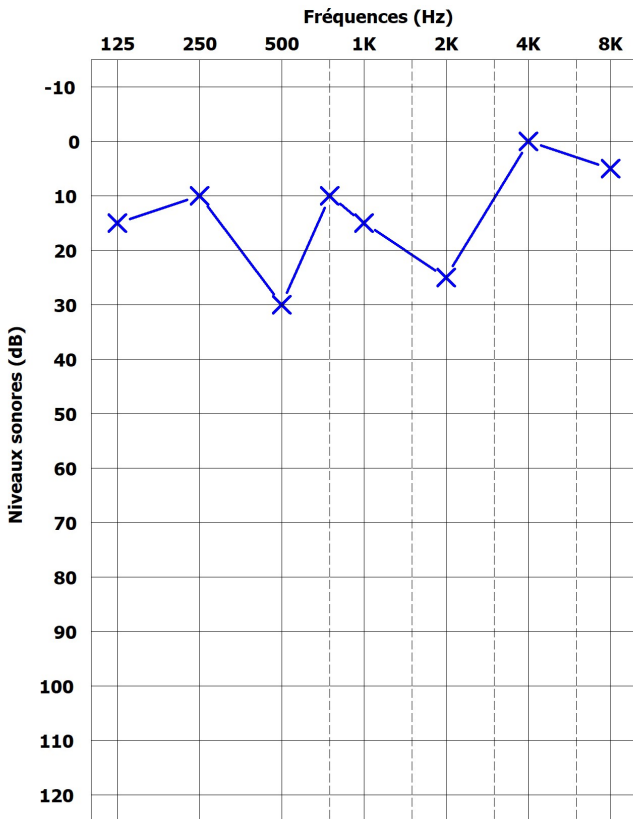

Oreille Gauche

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	10	30	10	15		25		0		5
CA Droit	10	10	10	10	5		20		-10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
	CA Gauche	17,5 dB
CA Droit	6,3 dB	---

Notes