


MEDVIE


Date du test: 27/06/2024 15:10:40

Durée: 5mn 18s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

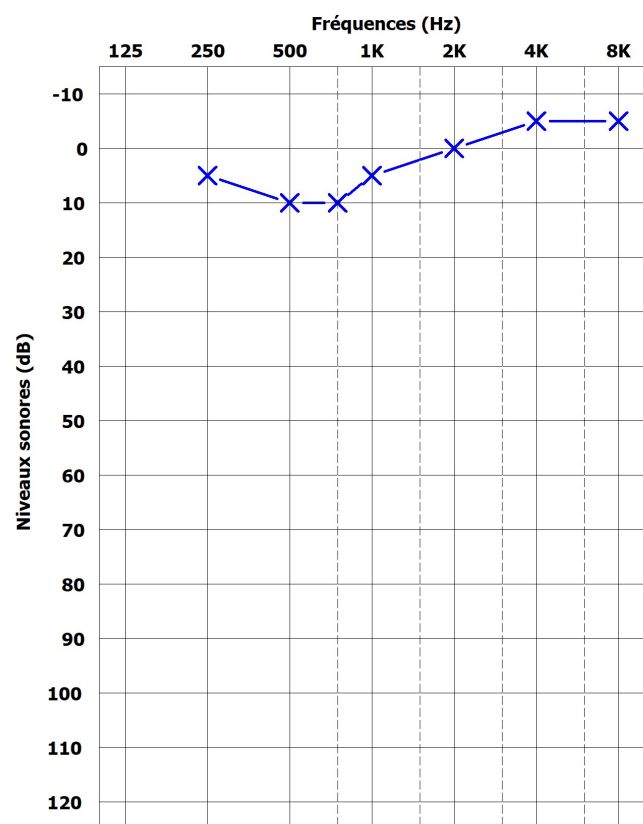

Oreille Gauche

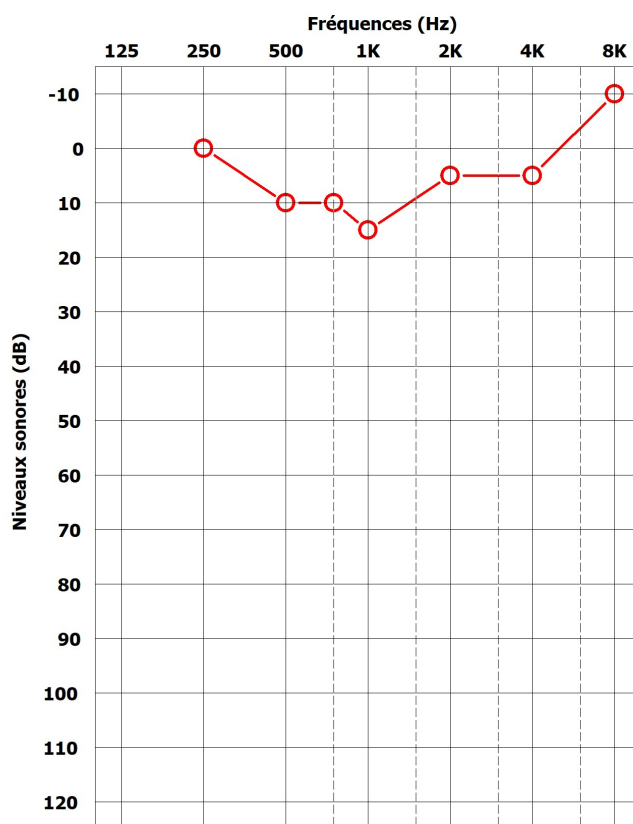

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	10	5		0		-5		-5
CA Droit		0	10	10	15		5		5		-10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes

Données Patient

PEPE DRAMOU

Date de naissance

05/03/1978

Age

46

Société

GST

ID

24062715081908635

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021