


MEDVIE


Date du test: 16/04/2025 11:03:25
Durée: 5mn 54s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
TOURE SIDI YAYA	
Date de naissance	09/11/1970
Age	54
Société	GST
ID	25041611002380209

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

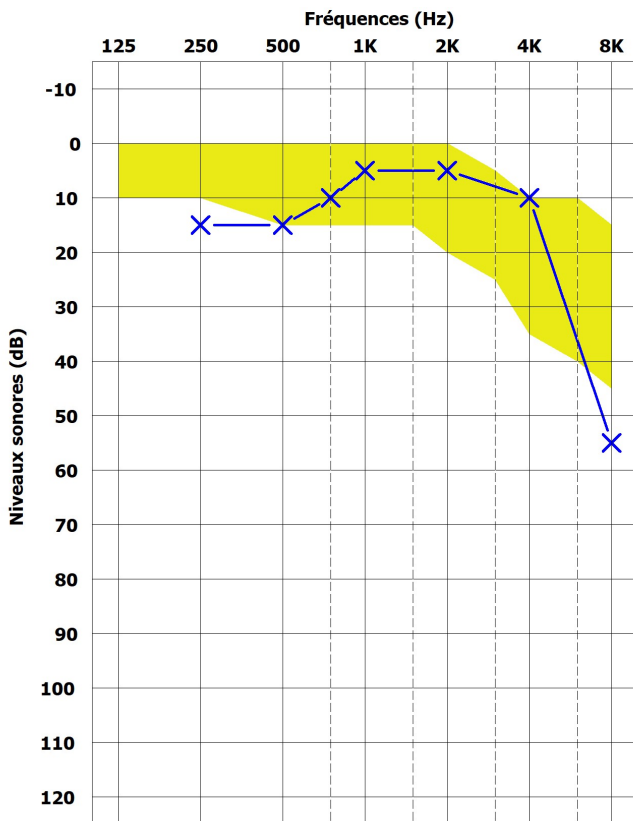

Oreille Gauche

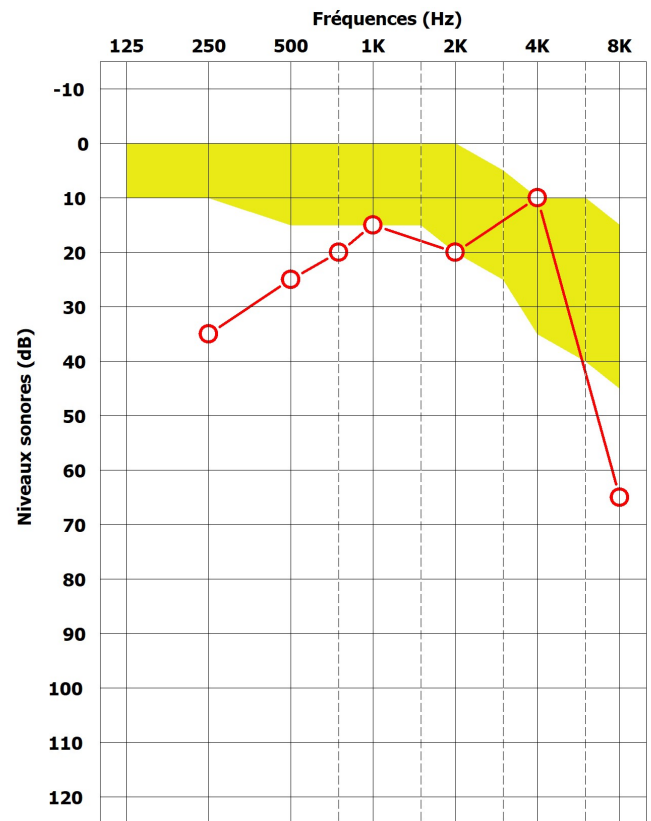

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	10	5		5		10		55
CA Droit		35	25	20	15		20		10		65

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes