


MEDVIE


Date du test: 16/04/2025 11:12:57
Durée: 3mn 25s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA SOULEYMANE	
Date de naissance	01/01/1972
Age	53
Société	GST
ID	25041611102717198

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

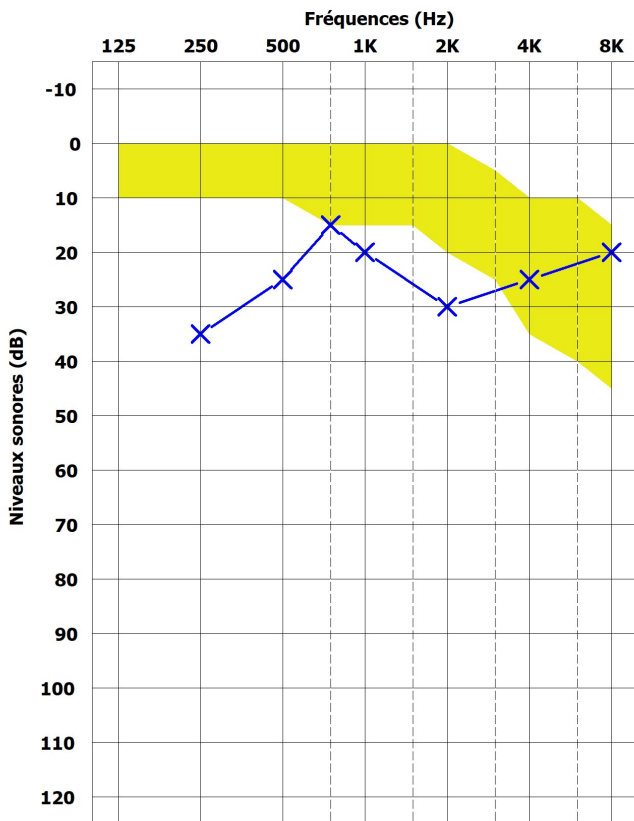

Oreille Gauche

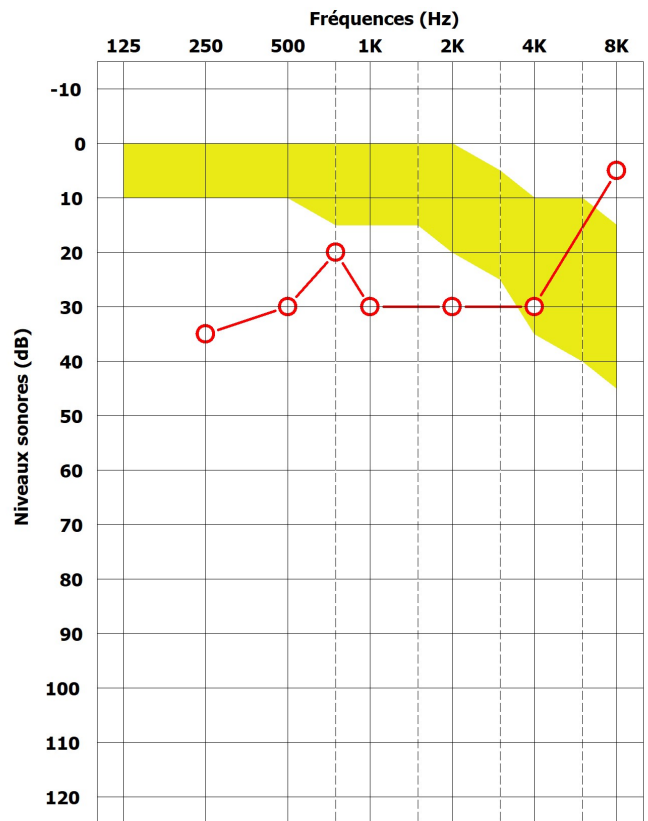

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	25	15	20		30		25		20
CA Droit		35	30	20	30		30		30		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	25,0 dB	---
CA Droit	30,0 dB	---

Notes