

MEDVIE

Date du test: 22/03/2024 10:27:32

Durée: 5mn 08s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

CONDE NVALY

Date de naissance

01/01/1992

Age

32

Société

GST

ID

24032210243544417

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021

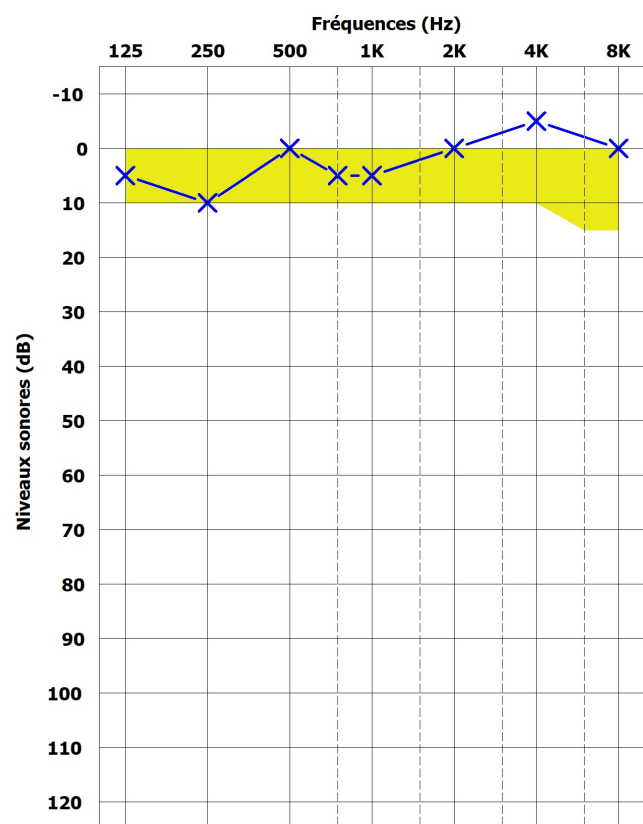

Oreille Gauche

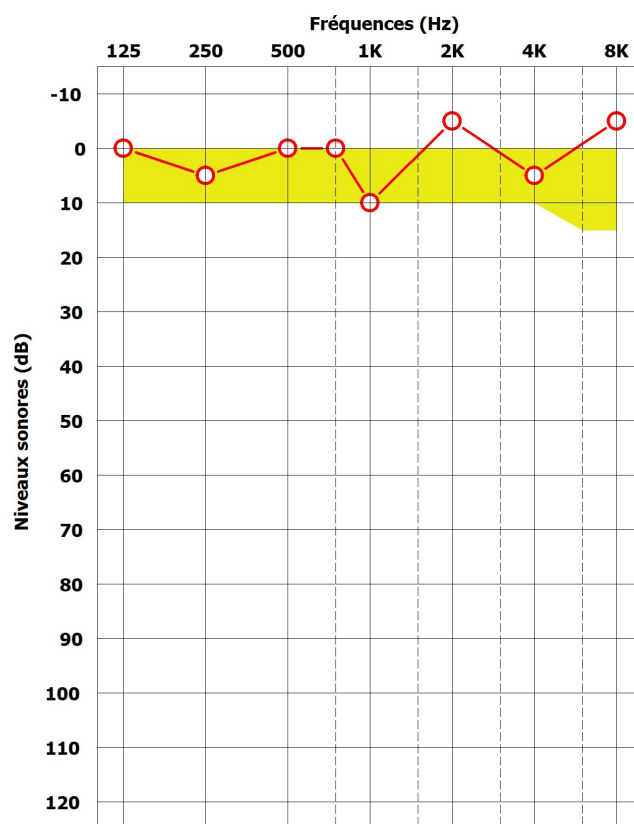

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	5	10	0	5	5		0		-5		0
CA Droit	0	5	0	0	10		-5		5		-5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	0,0 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes