


MEDVIE

Date du test: 25/03/2024 09:53:37

Durée: 5mn 10s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

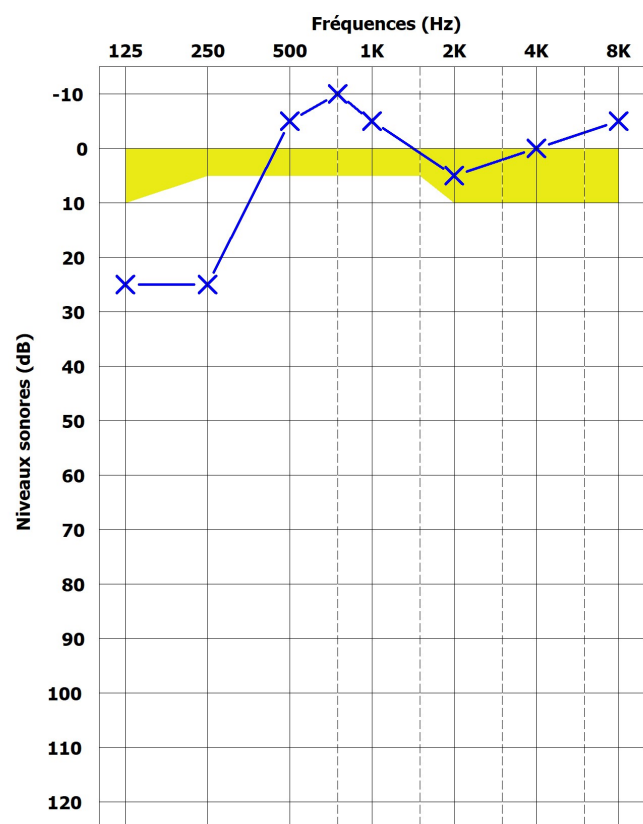

Oreille Gauche

Données Patient	
KEITA SIDIKI	
Date de naissance	01/01/1999
Age	25
Société	GST
ID	24032509353895025

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

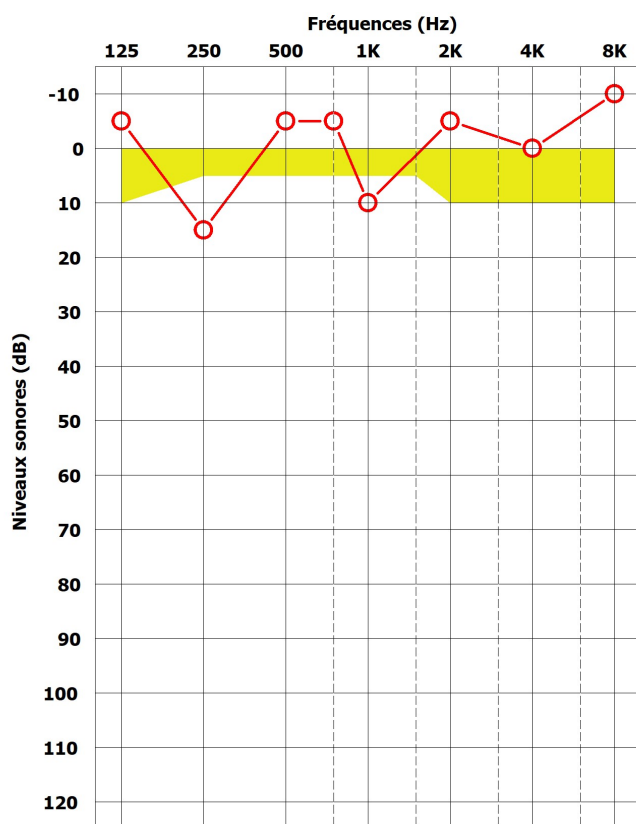

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	25	-5	-10	-5		5		0		-5
CA Droit	-5	15	-5	-5	10		-5		0		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-1,3 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes