

MEDVIE


Date du test: 20/03/2024 11:01:18

Durée: 6mn 54s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DOUKOURE ABOUBACAR	
Date de naissance	13/09/1982
Age	41
Société	GST
ID	24032010583577409

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

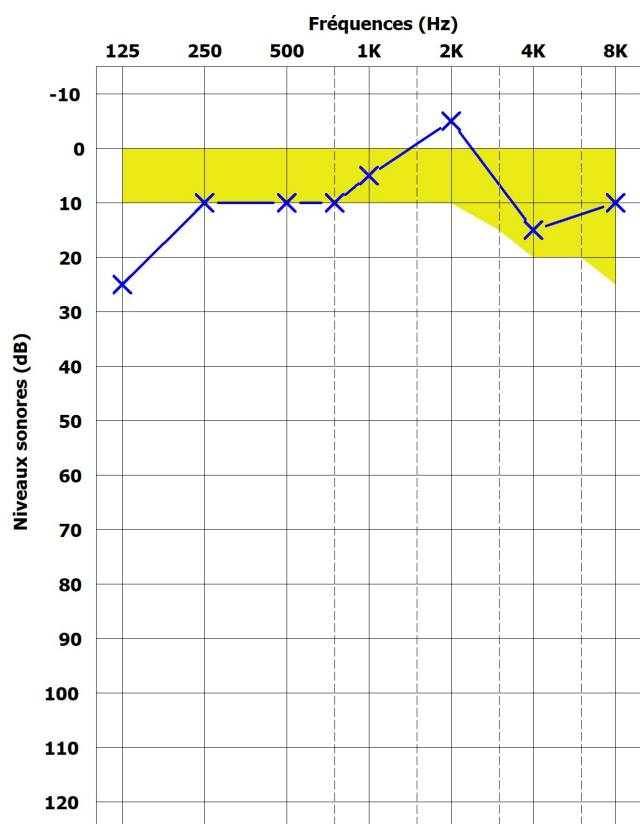

Oreille Gauche

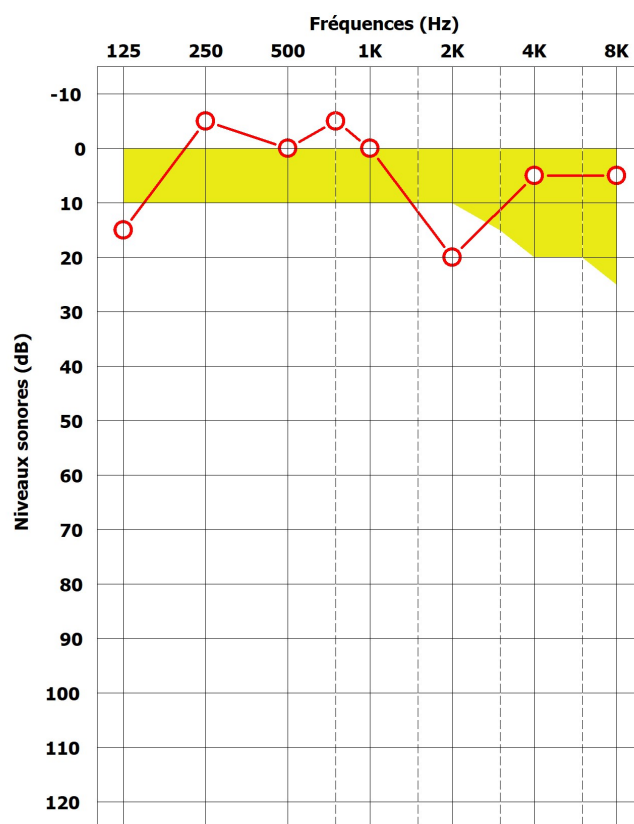

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	10	10	10	5		-5		15		10
CA Droit	15	-5	0	-5	0		20		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes