

MEDVIE


Date du test: 27/06/2024 14:58:55

Durée: 4mn 48s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOW ALPHA BOUBACAR	
Date de naissance	06/01/1983
Age	41
Société	GST
ID	24062714434894705

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

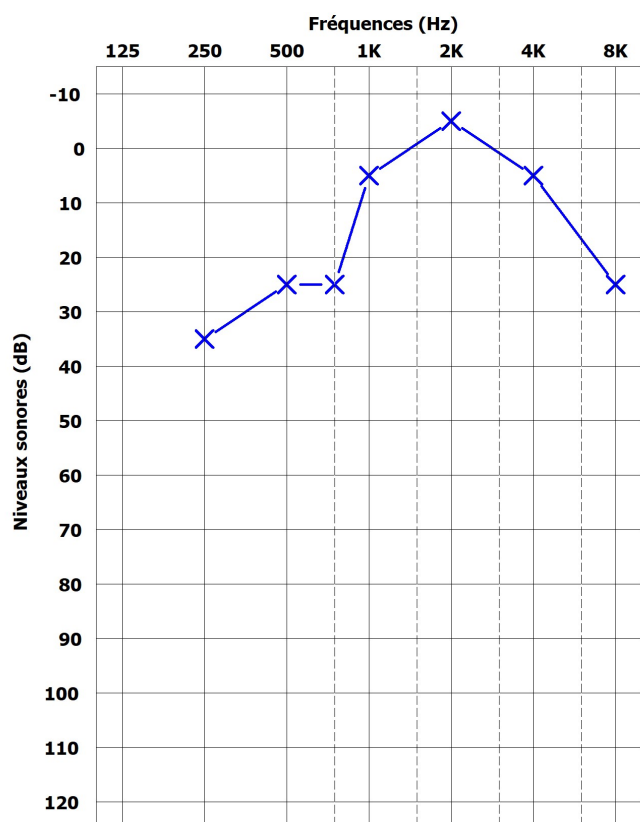

Oreille Gauche

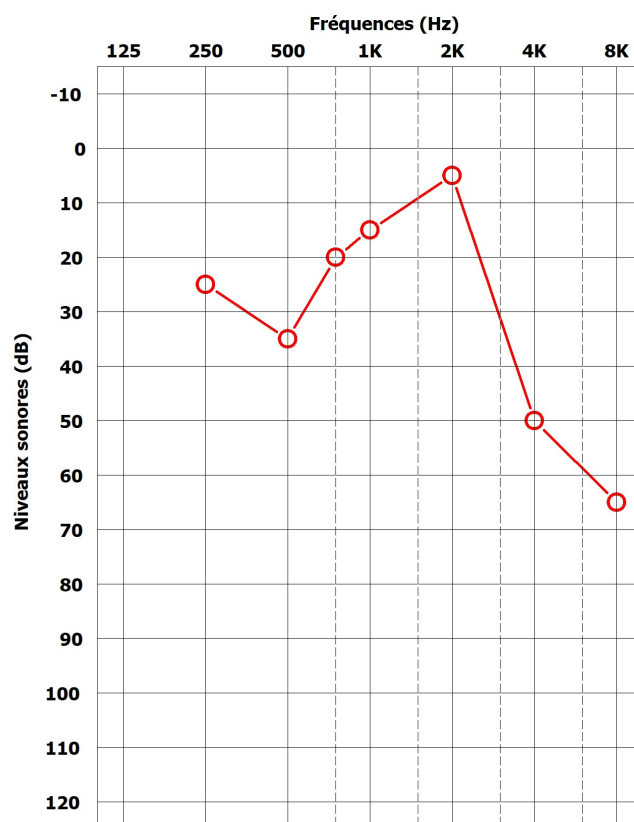

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	25	25	5		-5		5		25
CA Droit		25	35	20	15		5		50		65

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	26,3 dB	---

Notes