


MED VIE


Date du test: 27/06/2024 13:24:53
Durée: 3mn 58s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA ABOUBACAR	
Date de naissance	01/01/1988
Age	36
Société	GST
ID	24062713221557722

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

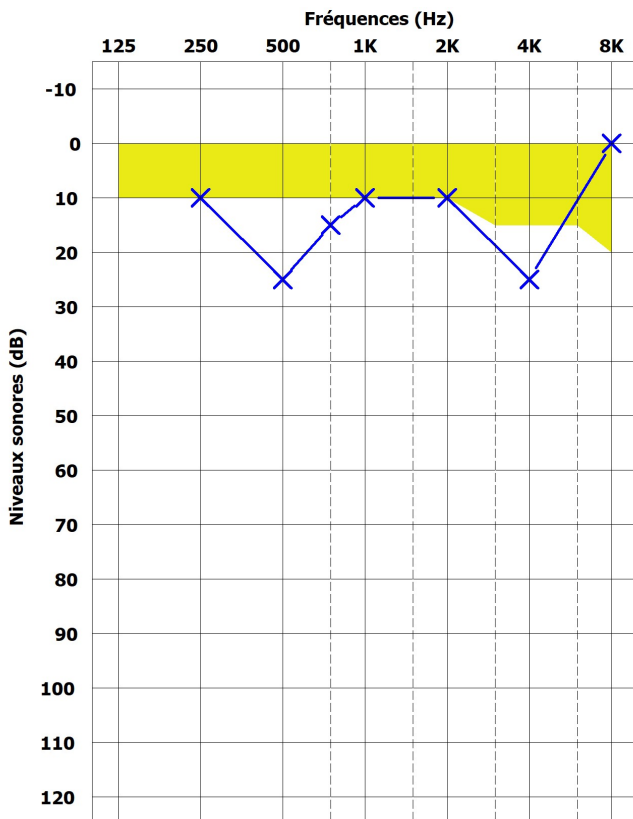

Oreille Gauche

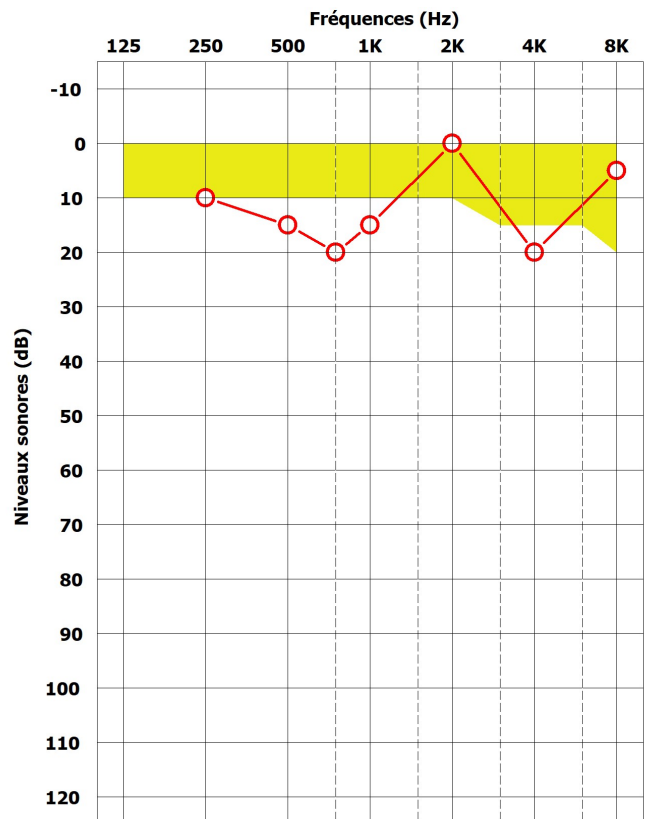

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	15	10		10		25		0
CA Droit		10	15	20	15		0		20		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes