


MEDVIE


Date du test: 18/05/2024 16:19:42
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
BAH MAMADOU BOBO	
Date de naissance	14/09/1986
Age	37
Société	IBS
ID	24051816130133137

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

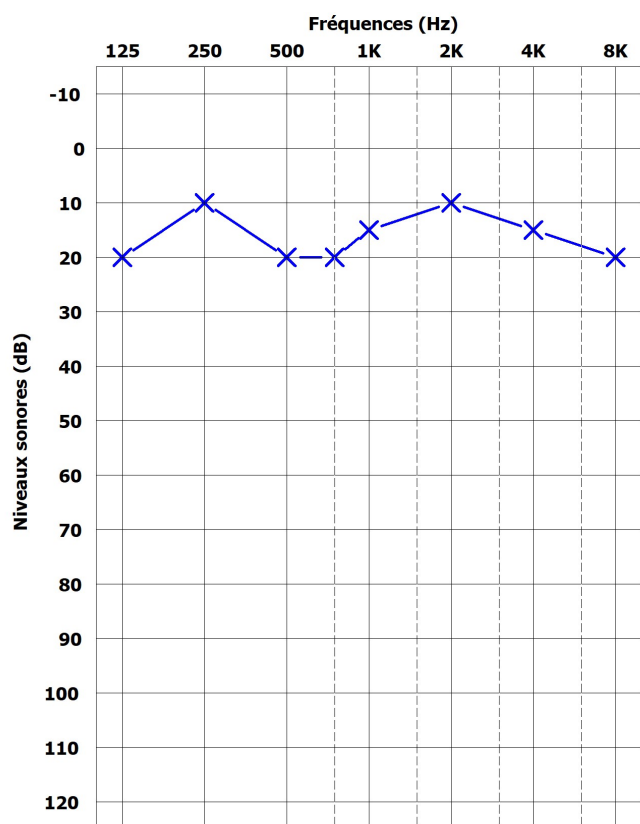

Oreille Gauche

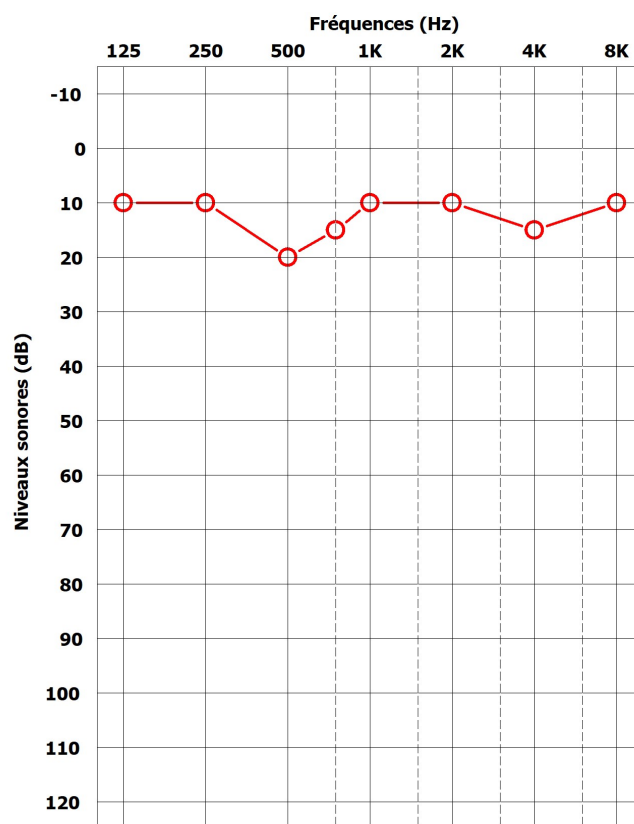

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	10	20	20	15		10		15		20
CA Droit	10	10	20	15	10		10		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes