


MEDVIE


Date du test: 18/05/2024 18:48:38
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	KOITA MAMADY
Date de naissance	01/01/1984
Age	40
Société	IBS
ID	24051818431533813

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

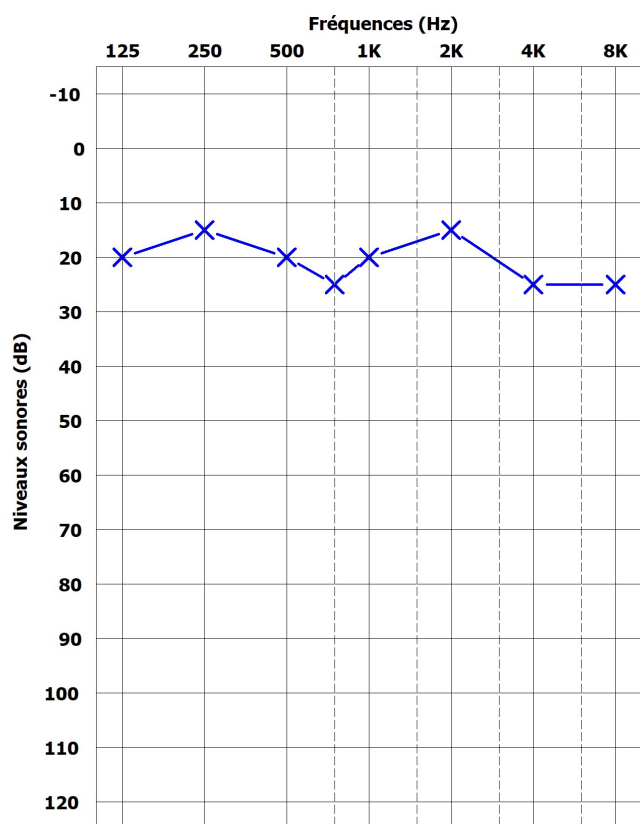

Oreille Gauche

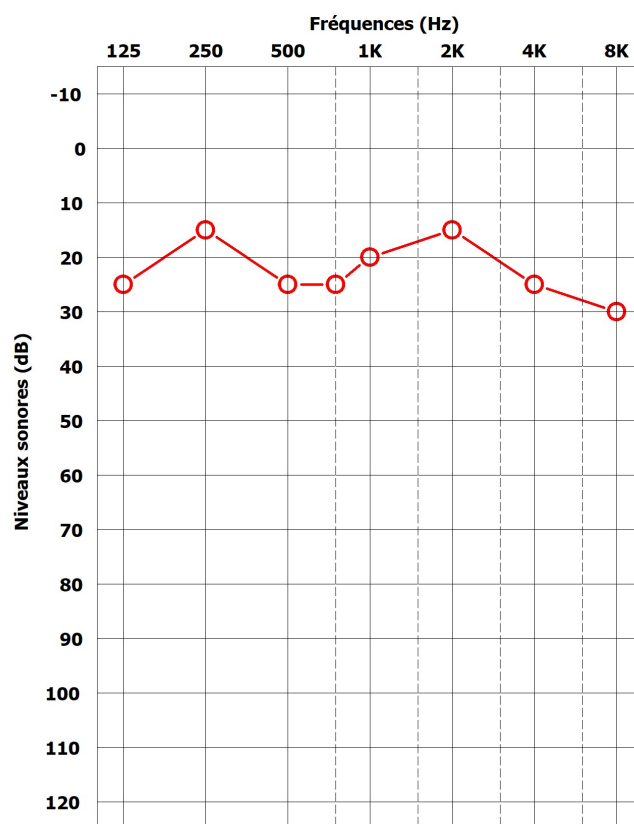

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	20	25	20		15		25		25
CA Droit	25	15	25	25	20		15		25		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes