

MED VIE


Date du test: 05/08/2024 13:49:14

Durée: 2mn 55s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KEITA DAOUDA
Date de naissance	19/12/1985
Age	38
Société	IBS
ID	24080513455338931

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

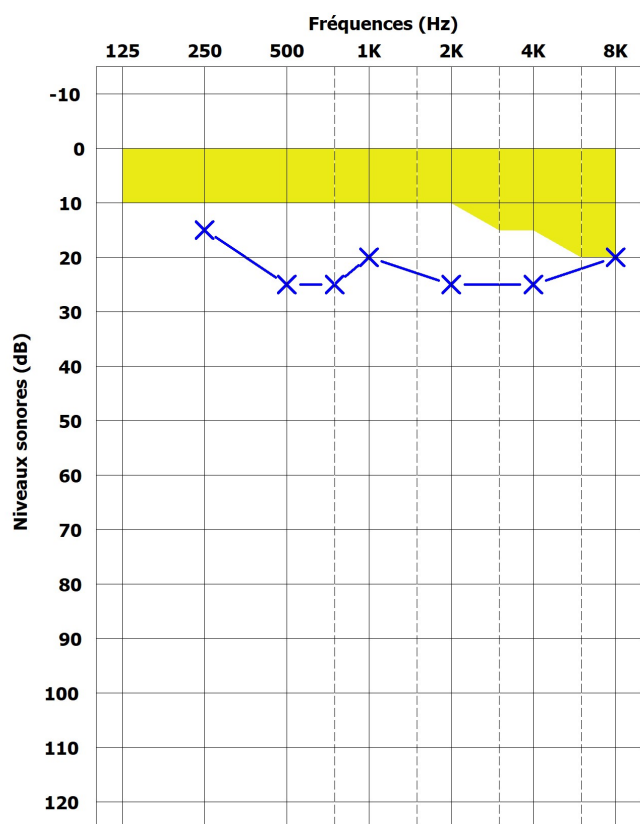

Oreille Gauche

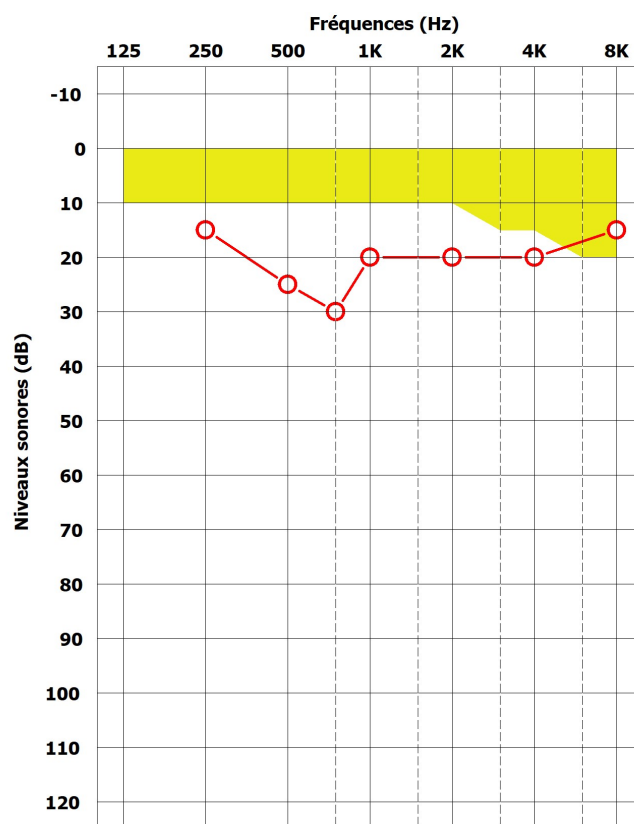

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	25	20		25		25		20
CA Droit		15	25	30	20		20		20		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes