


MEDVIE


Date du test: 30/08/2024 12:46:43
Durée: 6mn 10s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
OULD EL RHALIA JILALI	
Date de naissance	19/03/1980
Age	44
Société	IBS
ID	24083012375332174

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

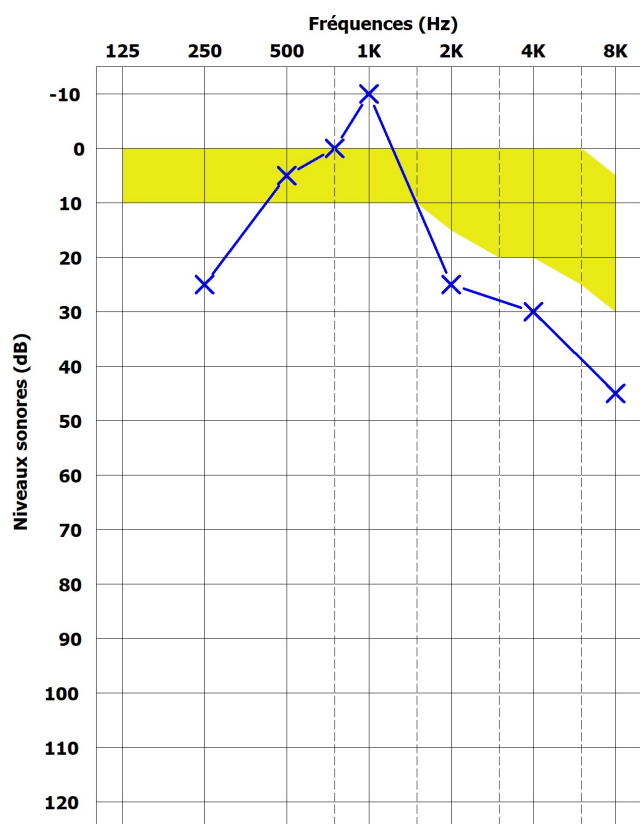

Oreille Gauche

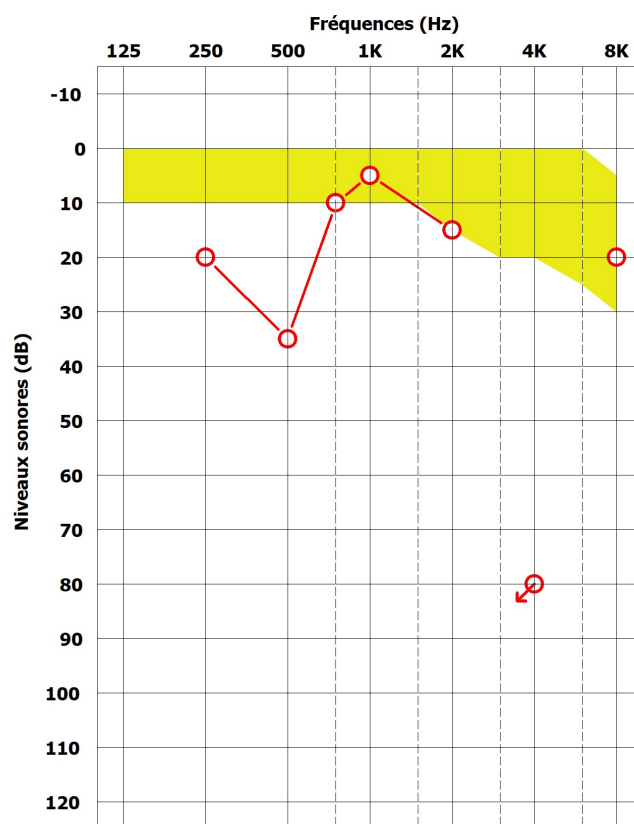

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	5	0	-10		25		30		45
CA Droit		20	35	10	5		15		(80)		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	---	---

Notes