


MEDVIE


Date du test: 13/05/2025 11:25:24
Durée: 6mn 04s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	AARAB AMMAR
Date de naissance	15/05/1985
Age	39
Société	IBS
ID	25051311163345747

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

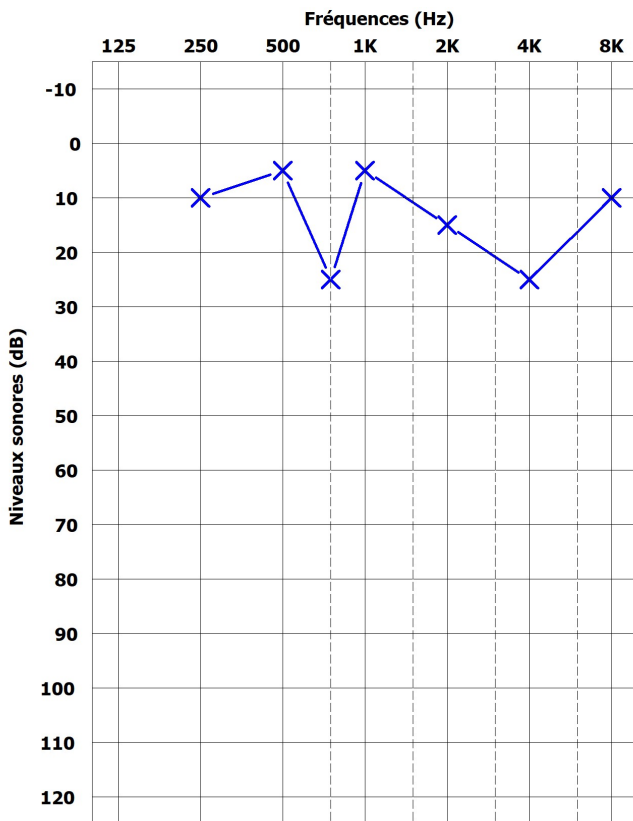

Oreille Gauche

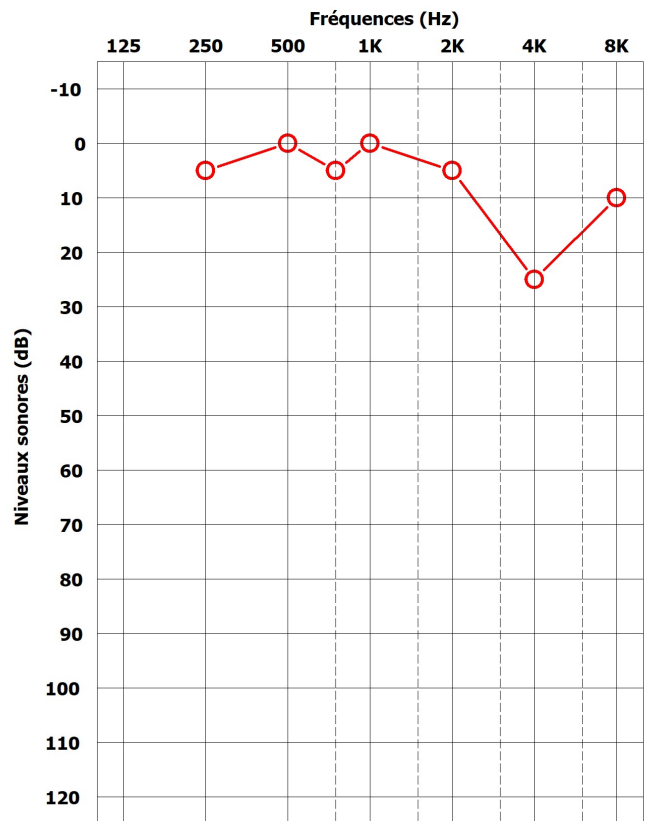

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	5	25	5		15		25		10
CA Droit		5	0	5	0		5		25		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes