


MEDVIE


Date du test: 09/09/2024 13:39:29
Durée: 4mn 44s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CIEGO BERNARDO	
Date de naissance	20/08/1957
Age	67
Société	IBS
ID	24090913192049405

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

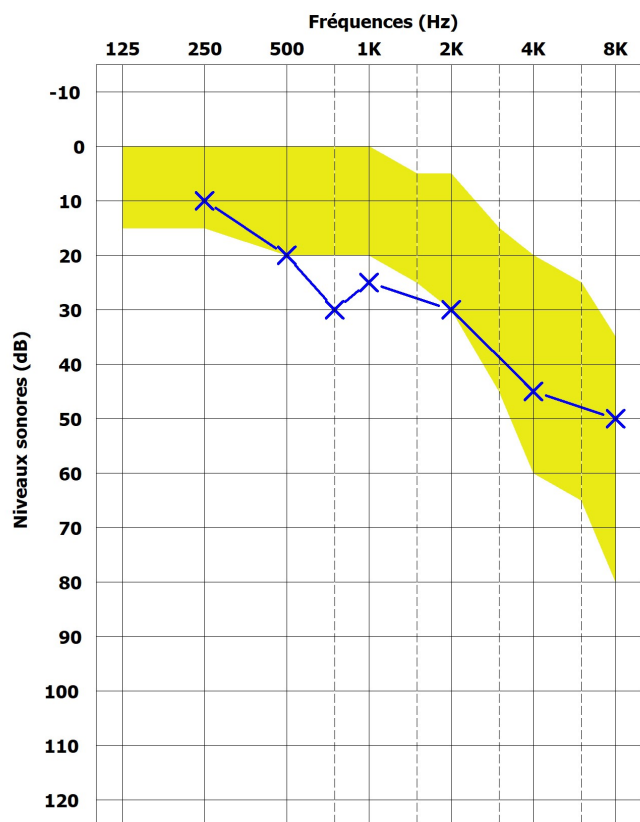

Oreille Gauche

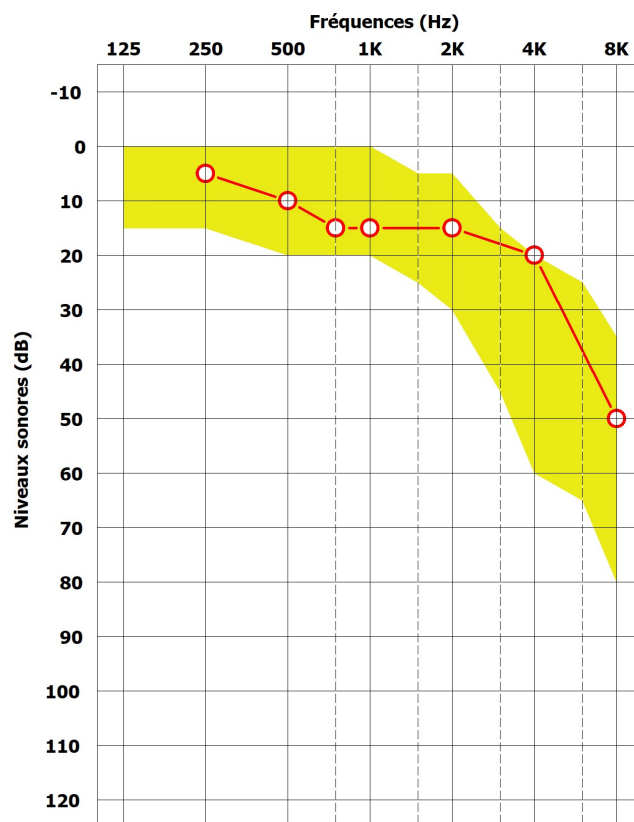

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	20	30	25		30		45		50
CA Droit		5	10	15	15		15		20		50

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	30,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes