

MEDVIE


Date du test: 30/08/2024 12:57:53

Durée: 4mn 27s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	HALLOUMI HAMID
Date de naissance	13/03/1982
Age	42
Société	IBS
ID	24083012560055097

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

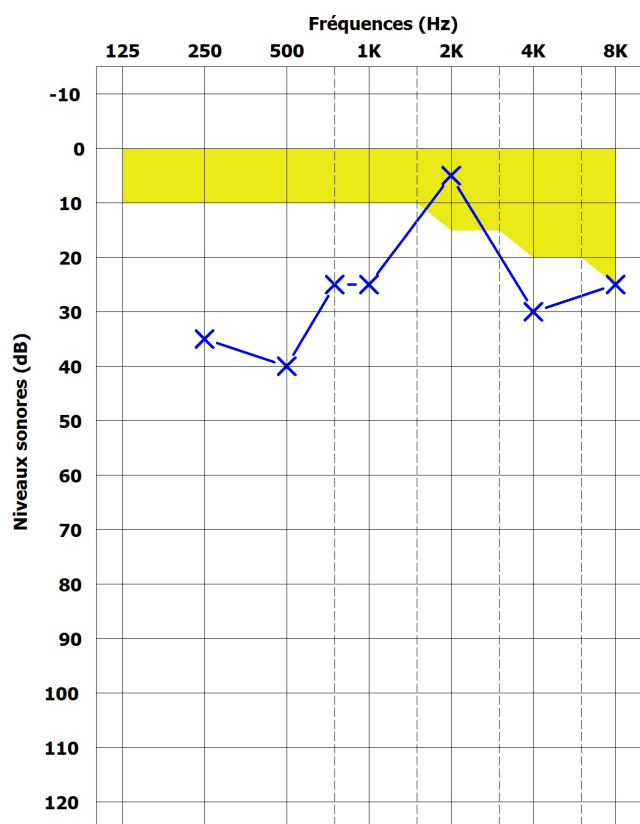

Oreille Gauche

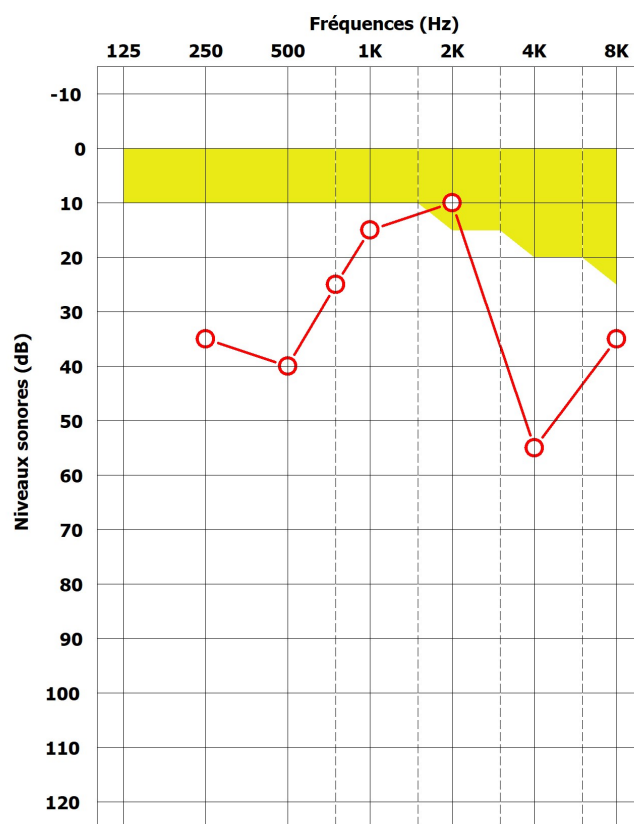

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	40	25	25		5		30		25
CA Droit		35	40	25	15		10		55		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	25,0 dB	---
CA Droit	30,0 dB	---

Notes