


MEDVIE


Date du test: 03/10/2024 14:58:21
Durée: 3mn 49s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BALDE FATOUMATA RINTA	
Date de naissance	01/12/1996
Age	27
Société	IBS
ID	24100314534511847

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

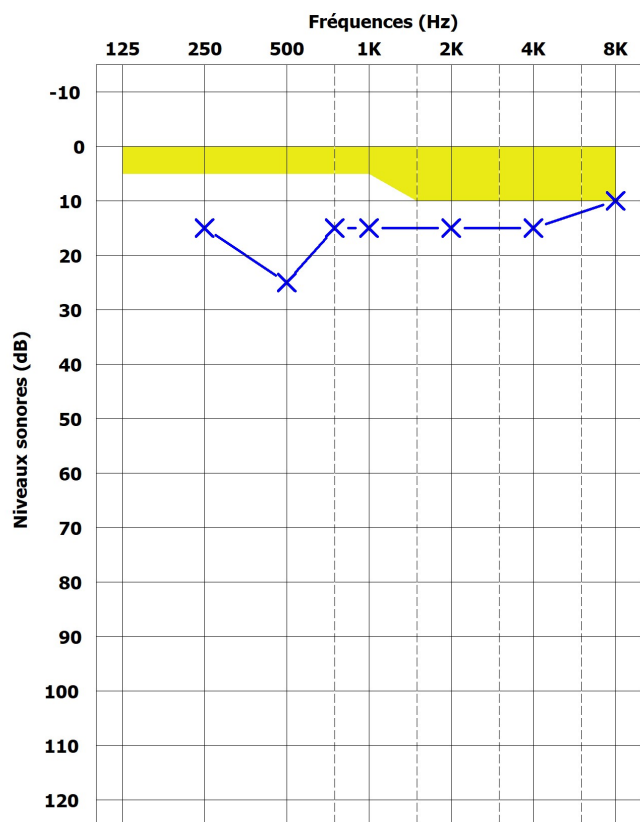

Oreille Gauche

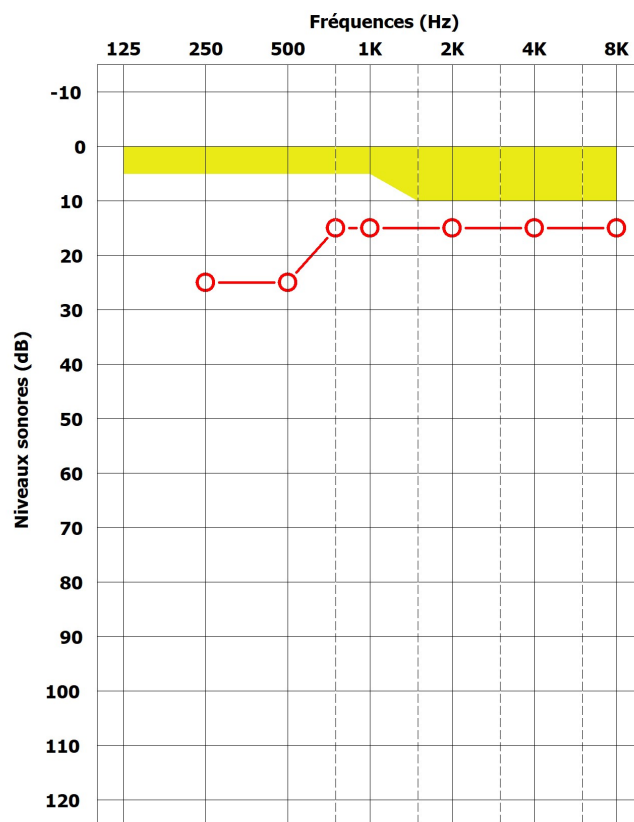

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	15	15		15		15		10
CA Droit		25	25	15	15		15		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes