

MEDVIE


Date du test: 02/08/2024 15:25:02

Durée: 4mn 42s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOUMAH SEKOU	
Date de naissance	10/10/1990
Age	33
Société	IBS
ID	24080215203180215

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

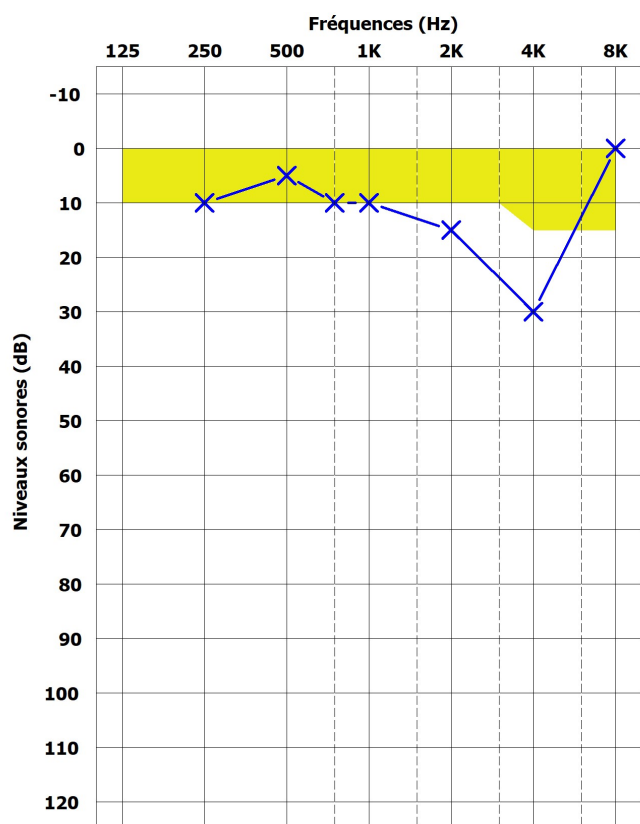

Oreille Gauche

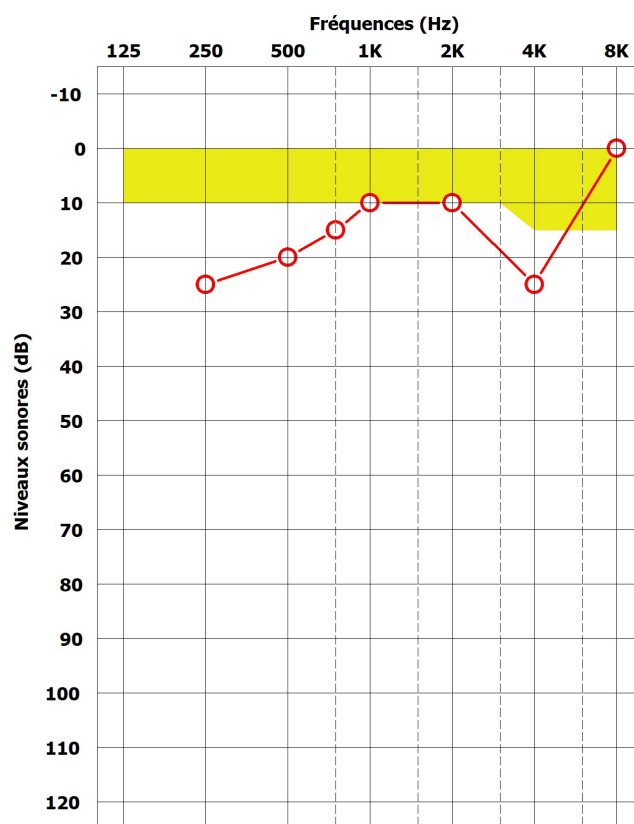

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	5	10	10		15		30		0
CA Droit		25	20	15	10		10		25		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes