

MEDVIE

Date du test: 09/05/2025 11:43:05

Durée: 4mn 19s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

JETRO TOLENTINO

Date de naissance 28/06/1977

Age 47

Société IBS


ID 25050911403617605

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

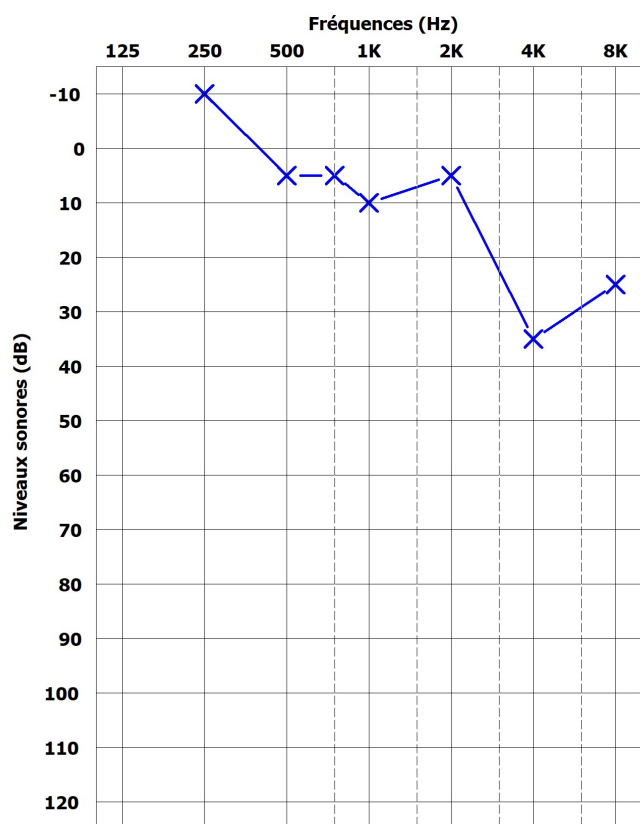

Oreille Gauche

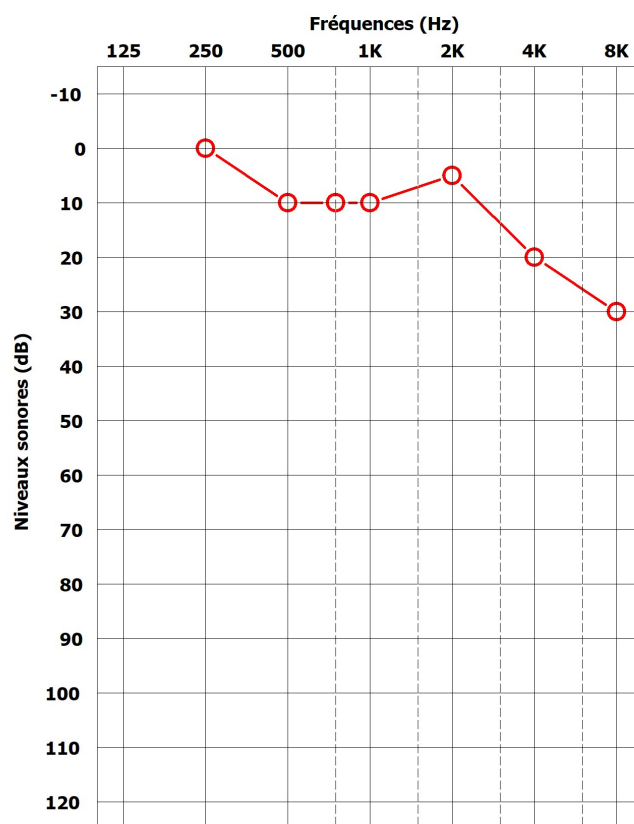

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	5	5	10		5		35		25
CA Droit		0	10	10	10		5		20		30

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes